ortò

CIZETA



CATALOGUE DE VENTE

ORTHOPÉDIE

PASSER COMMANDE

- Le Service Commercial en ligne **prend vos commandes sans interruption**
- **Du lundi au vendredi de 9h à 18h**
- Commande avant 15h, livraison le lendemain

Tel : 02 48 96 87 93 - Fax : 02 48 96 80 91
Mail : commande@cizetamedicali.fr
ou par Pharma ML

CIZETA MEDICALI 1872

SCIENCE & MEDICAL QUALITY

Code client : .....
Délégué(e) : .....
Email : .....
Tel : .....

ARBRES DÉCISIONNELS

RACHIS LOMBAIRE



Maintien abdominal

Hypogripp



p.24

Immobilisation

Corset d'hyper-extension



p.25

RACHIS CERVICAL

Soutien léger	Soutien semi-rigide	Immobilisation modérée	Immobilisation stricte
Torticolis Arthrose cervicale	Névralgie cervico-brachiale Arthrose cervicale	Névralgie cervico-brachiale Entorse bénigne Entorse moyenne	Entorse moyenne Entorse grave
ANATO C1	ANATO C2	ANATO C3	ANATO C4
			
p.28	p.28	p.29	p.29

ÉPAULE / BRAS

IMMOBILISATION ÉPAULE

GILET D'IMMOBILISATION	PERFO BRAS	ANNEAU CLAVICULAIRE	POLYVESTE	COUSSIN D'ABDUCTION 20°
				
p.34	p.32	p.35	p.35	p.33

MAIN / POIGNET

Rhumatologie | **Traumatologie** | **Traumatologie grave**

Gamme ATL SEAMLESS

ATL SEAMLESS POUCE



p.41

ATL SEAMLESS POIGNET



p.40

Gamme PERFO

PERFO POIGNET



p.43

PERFO POIGNET POUCE



p.43

MAIN

MI 70



p.42

GENOU

Besoin de maintien | **Reprise sportive et phase de rééducation** | **Immobilisation et Post-Op**

MAINTIEN LÉGER

GL STAB



p.52

MAINTIEN RENFORCÉ

PATELLA STAB



p.53

MAINTIEN INTENSE

GL STRAPP



p.53

PHASE RÉÉDUCATION INSTABILITÉ CHRONIQUE

GL 120 Standard



p.50

GL 120 Open



p.51

POST-OP LCA ET RÉÉDUCATION

CIROM



p.54

IMMOBILISATION APRÈS TRAUMATISME

PERFO UNI 3



p.55

CHEVILLE

Besoin de maintien | **Reprise sportive et phase de rééducation** | **Immobilisation et Post-Op**

Maintien léger

TALO STAB



p.64

Maintien renforcé

TALO PROTECT



p.65

Maintien intense

TALO STRAPP



p.65

Entorse moyenne à grave

CISTAB



p.62

A2T®



p.60

Entorse grave et fracture

CIZETA BOOTS



p.66

CIZETA BOOTS AIR



p.67

PIED

C.H.U.T CLASSIQUE



p.70

C.H.U.T DÉCHARGE ARRIÈRE



p.70

C.H.U.T DÉCHARGE AVANT



p.71

RELEVEUR DE PIED



p.72

CHAUSSURE PLÂTRE



p.71

RELEVEUR A2T®



p.72

CANNES ET ACCESSOIRES

CANNE CLASSIQUE



p.74

BANDAGE HERNIAIRE



p.75

PACK CHAUD / FROID



p.74

COUSSIN BINET



p.75

INNOVATION & BREVETS

Cizeta Medicali, fabricant depuis 1872 de textile compressif

Pour le développement de ses solutions thérapeutiques, **CIZETA MEDICALI** s'entoure de spécialistes en médecine physique et de réadaptation, chirurgiens orthopédiques et médecins du sport.

Notre mission : comprendre leurs attentes et innover au service du patient : lever les freins à l'observance du traitement en développant des orthèses alliant efficacité, confort et esthétisme pour retrouver progressivement mobilité et autonomie.

L'agilité de notre structure à taille humaine nous assure des cycles de conception et de développement courts pour répondre aux besoins liés à l'évolution des pathologies et des pratiques.


La gamme Cizeta Ortó s'est spécialisée **dans le traitement des troubles musculo-squelettiques d'origine traumatiques et rhumatiques** avec un focus particulier sur la prise en charge de l'entorse de cheville avec l'**A2T®** et de la lombalgie avec la **Gamme SL**.


Pour chaque nouvelle orthèse, notre équipe d'ingénieurs recherche les matériaux novateurs offrant au produit des caractéristiques exclusives en réponse aux objectifs thérapeutiques définis par notre responsable scientifique, rééducateur fonctionnel diplômé.


1872 Centenari & Zinelli


Naissance de Centenari & Zinelli à Milan, la plus ancienne société italienne de production de tissus élastiques









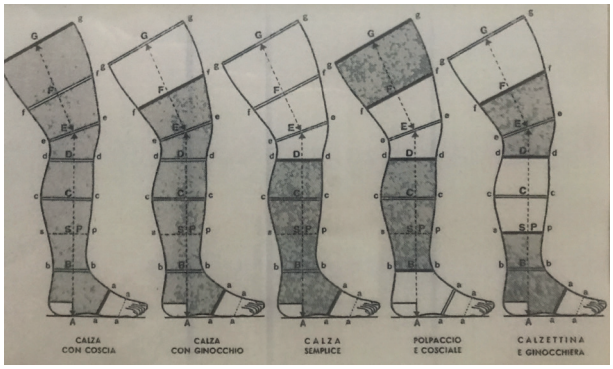

Passer commande en appelant le laboratoire :
(commande avant 15h, livraison le lendemain)

- Tel : 02 48 96 87 93 ▸ Fax : 02 48 96 80 91
- Du lundi au vendredi de 9h à 18h
- Email : commande@cizetamedicali.fr
- Ou par Pharma ML

5 BREVETS
Au service de l'observance

A2T® MODÈLE BREVETÉ

La nouvelle génération d'orthèse stabilisatrice



Veinalgic®

Prévention et traitement des effets secondaires après sclérose des varices



Varitec

Enfile bas



MI 70 MODÈLE BREVETÉ

La nouvelle génération d'attelle d'immobilisation pour la fracture des métacarpiens



Bandes Cizeta Press CP 35 Picots


Favorise l'autobandage



INNOVATION & MODÈLES

Dans chaque segment, une innovation brevetée au service de l'observance

5 MODÈLES DÉPOSÉS
Rachis lombaire

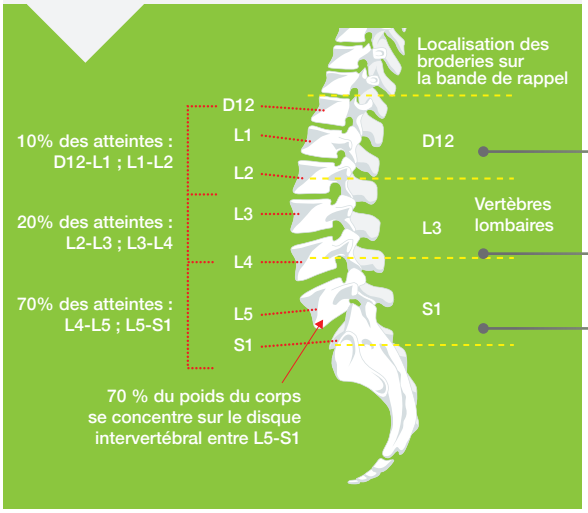



Bande de rappel avec dossard brodé
D12 - L3 - S1 : cible la douleur

SL 500 GRIS



SL 500



SL Thermo



SL 700



SL Lady



SL Maternity




3 MODÈLES DÉPOSÉS
Genou

Anneau rotulien en forme de strapping (en X) pour augmenter le recentrage de la rotule durant l'activité



Cet anneau rotulien permet grâce à ses pelotes internes d'augmenter la stimulation du quadriceps (principalement vaste interne et vaste externe) afin de favoriser le recentrage actif de la rotule au cours du mouvement.

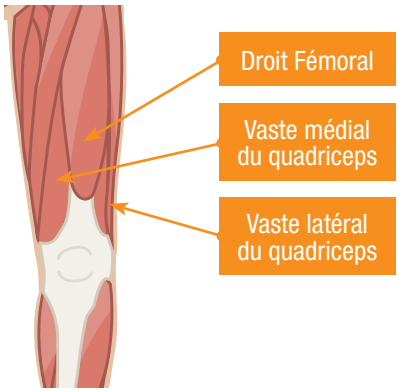

PATELLA STAB



GL STRAPP



GL 120



POURQUOI CIZETA ORTÒ ?

Recherche et développement

L'entorse de cheville, un traumatisme fréquent à ne pas prendre à la légère

Les entorses latérales de la cheville constituent une des atteintes les plus fréquentes de l'appareil locomoteur, on estime **sa fréquence à 1/10 000 par jour**.

L'amélioration de nos connaissances sur le complexe articulaire tibio-tarsien montre que cette lésion est responsable de bien plus de dommages et a pour conséquence des séquelles lésionnelles fréquentes et un taux de récidive dépassant souvent les 30% la première année.

Aujourd'hui, **l'entorse latérale constitue un sérieux problème de santé publique en raison des coûts directs ou indirects qu'elle engendre** (traitements, indisponibilité professionnelle, séquelles dont 5 à 20% d'instabilité chronique).


Certes, **des avancées ont été faites depuis une vingtaine d'années**, que ce soit en matière d'imagerie (règles d'Ottawa [1], démembrement échographique des lésions), d'examen clinique ou de traitement [2-6] **mais des progrès restent à faire**.

Ainsi, le diagnostic lésionnel précis à la phase aiguë (J0) est toujours un challenge difficile, même pour les cliniciens les plus expérimentés, car l'imagerie spécifique ne peut, pour des raisons de nombre, être faite de manière systématique en urgence.

Aussi, en pratique quotidienne, **l'examen clinique locorégional rigoureux**, et surtout répété dans le temps, demeure **la solution la plus simple et la plus recommandée** pour mieux évaluer la laxité et rechercher des lésions associées. **Les lésions concomitantes** à l'atteinte du ligament collatéral latéral sont nombreuses comme l'ont montré plusieurs études : Roemer en 2014 [10] et Großterlinden en 2016 [11].

Le traitement de l'entorse latérale de la cheville comporte deux objectifs :

- Gérer la douleur : protocole GREC (Glaçage, Repos, Élévation, Compression), antalgiques per os
- Aider à la cicatrisation des lésions (mobilisation en secteur protégé).

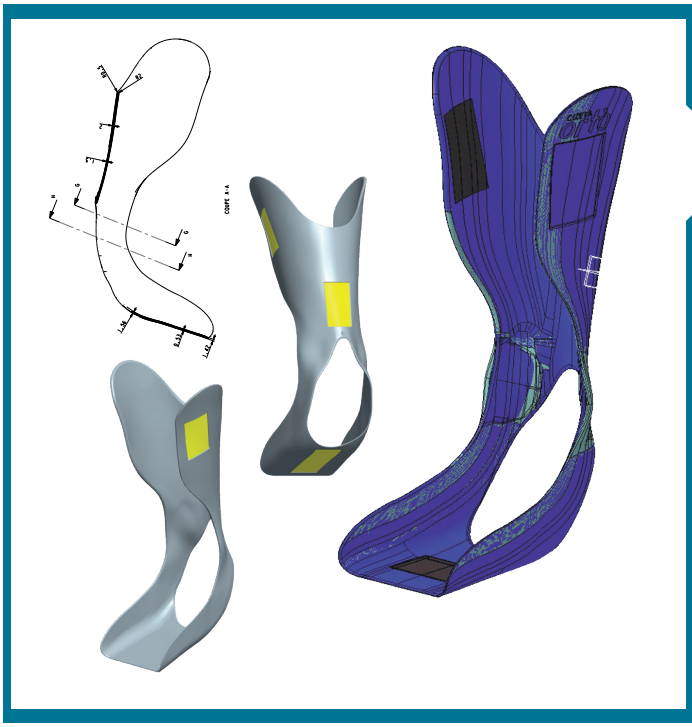

BREVET INTERNATIONAL

L'orthèse à double coque est actuellement le moyen le plus utilisé pour réaliser cette immobilisation partielle.

Cependant, **son concept ne vise qu'à limiter la bascule en varus** et non les autres secteurs, restriction nécessaire en cas de lésions combinées.

Malgré les avantages très attrayants de ce mode d'immobilisation, **la fréquence encore trop élevée des complications post-entorses souligne la nécessité de continuer à améliorer la prise en charge** de cette lésion. Van Rijn en 2008 [8] a, par des données chiffrées, clairement posé le problème.

Retrouvez l'A2T page 60 du catalogue

1. Stiell IG, Greenberg GH, McKnight RD, et al. Decision rules for the use of radiography in acute ankle injuries. Refinements and prospective validation. JAMA 1993;269:1127–3
2. Bauer T, Hardy P. Entorses de la cheville. EMC-Appareil Locomoteur. Paris:Elsevier Masson SAS; 2011 [14-089-A-10].
3. Kemler E, van de Por I, Schmikli S, Huisstede B, Backx A. Effects of soft bracing or taping on a lateral ankle sprain: a non-randomised controlled trial evaluating recurrence rates and residual symptoms at one year. J Foot Ankle Res 2015 ; 8:13 doi 10.1186/s13047-015-0069-6
4. Kerkhoffs GMMJ, Struijs PAA, Marti RK, et al. Functional treatments for acute rupture of the lateral ankle ligament. Acta Orthop Scand 2003;74:69–77.
5. Kerkhoffs GMMJ, Handoll HH, de Bie R, et al. Surgical versus conservative treatment for acute injuries of the lateral ligament complex of the ankle in adults.Cochrane Database Syst Rev 2007;18:CD000380 [Cochrane Review].
6. Petersen W, Rembitzki I, Gösele Koppenburg A, Ellermann A. Treatment of acute ankle ligament injuries: a systematic review. Arch Orthop Trauma Surg 2013 ; 133:1129–1141
7. Stover CN. A Functional Semirigid Support System for Ankle Injuries. Phys Sportsmed. 1979 ; 7(5):71-8.
8. van Rijn RM, van Os AG, Bernsen RM, Luijsterburg PA, Koes BW, Bierma-Zeinstra SM What is the clinical course of acute ankle sprains? A systematic literature review. Am J Med. 2008 ;121:324-331.
9. L Konradsen, L Bech, M Ehrenbjerg : Seven years follow-up after ankle inversion trauma. Scand J Med Sci Sports 2002; 12: 129-135
10. Roemer FW, Jomaah N, Niu J, Almusa E, Roger B, D'Hooghe P, Geertsema C, Tol JL, Khan K, Guermazi A. Ligamentous Injuries and the Risk of Associated Tissue Damage in Acute Ankle Sprains in Athletes: A Cross-sectional MRI Study. Am J Sports Med. 2014 ;42:1549-57.
11. Großterlinden LG, Hartel M, Yamamura J, Schoennagel B, Bürger N, Krause M, Spiro A, Hoffmann M, Lehmann W, Rueger JM, Rupprecht M. Isolated syndesmotic injuries in acute ankle sprains: diagnostic significance of clinical examination and MRI. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2016 A;24:1180-6.

ACTUALITÉ

L'étude clinique menée par Cizeta Medicali confirme les 30% de récidive après entorse de cheville.

L'étude a comparé le délai de reprise de la marche sans douleur après entorse de la cheville de grade I et II du ligament collatéral latéral (lésion fonctionnelle du faisceau antérieur LTFA et lésion possible du LCF) avec une orthèse stabilisatrice de cheville (A2T®) versus une orthèse à double coque*.

95% des patients recommandent l'A2T® suite à son utilisation
(confort et efficacité)

*Essai contrôlé, randomisé, conduit en ouvert de mai 2015 à juin 2016 ; réception des données le 04/07/2016. Data-Manager : CENBIOTECH DIJON

Principaux résultats de l'étude clinique :

- 2 jours — **REPRISE DE LA MARCHE**
Amélioration du délai de reprise de la marche :
- 2.2 jours avec l'A2T
- 4.2 jours avec une double coque

+37% — **AMÉLIORATION DE L'ÉVOLUTION DE L'ENTORSE**
+37% d'amélioration selon les cliniciens : diminution de l'oedème, des ecchymoses et de la douleur.
- 93% des entorses s'améliorent avec l'A2T
- 68% avec une double coque, soit 1 entorse sur 3 qui n'évolue pas correctement.

+36% — **OBSERVANCE**
Amélioration de l'observance de plus de 36% avec l'A2T.



Vidéo innovation



Vidéo Prix Galien



Vidéos disponibles sur la chaîne Youtube Cizeta Medicali

SEGMENTATION PAR BESOIN

Une réponse à chaque pathologie & à chaque moment de la vie

RACHIS LOMBAIRE

Urgences, traumatologie du sport et Post-op

Corset d'hyper-extension



Post-Op

Hypogripp



Chronique et rhumatologie

Ceintures gamme SL

SL 350



SL Lady



SL Maternity



LA SL



SL 500



SL 500 gris



SL 700



SL Thermo



RACHIS CERVICAL

Urgences, traumatologie du sport et Post-op

Anato C3



Anato C4



Chronique et rhumatologie

Anato C1



Anato C2



EPAULE BRAS

Urgences, traumatologie du sport et Post-op

Anneau claviculaire



Perfo bras



Polyveste



Coussin d'abduction 20°



Chronique et rhumatologie

Gilet d'immobilisation



MAIN POIGNET

Urgences, traumatologie du sport et Post-op

MI 70



Perfo Poignet & Perfo Poignet Pouce



ATL Seamless Poignet



Chronique et rhumatologie

ATL Seamless Poignet



ATL Seamless Pouce



SEGMENTATION PAR BESOIN

GENOU

Urgences, traumatologie du sport et Post-op

Perfo Uni 3



CIROM



Chronique et rhumatologie

GL 120

Standard



Open



Gamme élastique

GL Stab



Patella Stab



GL Strapp



CHEVILLE

Urgences, traumatologie du sport et Post-op

A2T®



Bottes de marche

Boots



Boots Air



Chronique et rhumatologie

Gamme élastique

Talo Stab



Talo Protect



Talo Strapp



PIED

Urgences

Chaussures plâtre



Urgences / Post-op

Chaussures C.H.U.T.

Classique



Décharge arrière



Décharge avant



Chronique et neurologie

Releveur statique

Releveur du pied



Releveur dynamique

Releveur A2T®



CANNES AUTRES

Urgences, traumatologie du sport et Post-op

Cannes et accessoires

Classique





Coussin Binet



Chronique et rhumatologie

Bandage herniaire



CIZETA ACADEMIE - ORTHOPÉDIE

Un service dédié à l'accompagnement de nos clients afin de devenir experts dans la prise en charge de la maladie veineuse et dans les pathologies ostéo-articulaires.

Cizeta Académie se compose de modules permettant de faire progresser les équipes au conseil et à l'application des produits de la gamme Cizeta Ortò.
Tous ces modules se valident par des mises en situation et des cas de comptoir.

Par qui ?

Nos délégués experts vous accompagnent dans la mise en place de la formation continue de vos équipes.



CIZETA ACADEMIE - ORTHOPÉDIE

Cizeta Académie Orthopédie :
devenez des experts des pathologies ostéo-articulaires

Un programme composé de 4 modules permettant de :


- Acquérir les capacités à comprendre les nombreuses pathologies ostéo-articulaires d'origine traumatiques, neurologiques, rhumatologiques,…
- Faciliter la délivrance de l'appareillage avec des outils simples et rapides.
- Devenir expert en conseils associés afin d'accompagner vos patients dans leur traitement, l'inobservance étant la première cause d'échec du traitement




CIZETA

RACHIS LOMBAIRE

COMMENT BIEN DÉLIVRER UNE CEINTURE LOMBAIRE ?

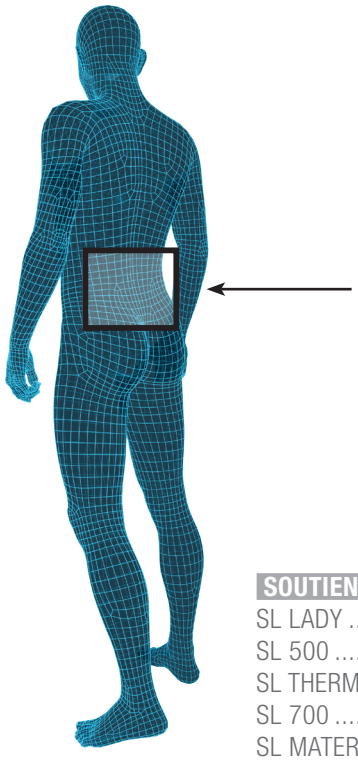



PRISE DE MESURE :

1. **En fonction du stade de la lombalgie** et du niveau d'activité professionnelle ou de loisir du patient, délivrez la ceinture la plus adaptée en utilisant l'arbre décisionnel
2. **Prise de mesure :** prenez le tour de taille du patient, 2 cm au dessus des crêtes iliaques
3. **Essayage et mise en place**
   - Adapter le baleinage en fonction de la cambrure du patient
   - Montrer la mise en place sur vous-même puis laisser le patient positionner la ceinture et corriger si besoin
   - Rappeler le temps de port selon la pathologie

SOUTIEN LOMBAIRE
SL LADY 17
SL 500 18
SL THERMO 19
SL 700 20
SL MATERNITY 23
SL 350 21
LA SL 21

SOUTIEN ABDOMINAL
HYPOGRIPP 24

CORSET
CORSET D'HYPER-EXTENSION 25

ARBRE DÉCISIONNEL



PATHOLOGIES ET SOLUTIONS


Le saviez-vous ?

Le rachis = colonne vertébrale

- **33 vertèbres**
- Seulement **24 sont mobiles**

Le rachis a pour fonction de :

- **Protéger** la moelle épinière
- Donner la **mobilité** au corps

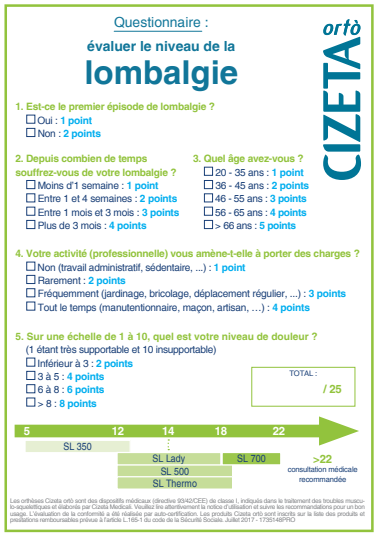
Questionnaire :
évaluer le niveau de la
lombalgie
ortò CIZETA

1. Est-ce le premier épisode de lombalgie ?
☐ Oui : 1 point
☐ Non : 2 points

2. Depuis combien de temps souffrez-vous de votre lombalgie ?
☐ Moins d'1 semaine : 1 point
☐ Entre 1 et 4 semaines : 2 points
☐ Entre 1 mois et 3 mois : 3 points
☐ Plus de 3 mois : 4 points

3. Quel âge avez-vous ?
☐ 20 - 35 ans : 1 point
☐ 36 - 45 ans : 2 points
☐ 46 - 55 ans : 3 points
☐ 56 - 65 ans : 4 points
☐ > 66 ans : 5 points

4. Votre activité (professionnelle) vous amène-t-elle à porter des charges ?
☐ Non (travail administratif, sédentaire, ...) : 1 point
☐ Rarement : 2 points
☐ Fréquemment (jardinage, bricolage, déplacement régulier, ...) : 3 points
☐ Tout le temps (manutentionnaire, maçon, artisan, ...) : 4 points

5. Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau de douleur ?
(1 étant très supportable et 10 insupportable)
☐ Inférieur à 3 : 2 points
☐ 3 à 5 : 4 points
☐ 6 à 8 : 6 points
☐ > 8 : 8 points

TOTAL : / 25

5 12 14 18 22
SL 350
SL Lady
SL 700
SL 500
SL Thermo
>22 consultation médicale recommandée

Les orthèses Cizeta ortò sont des dispositifs médicaux (directive 93/42/CEE) de classe I, indiqués dans le traitement des troubles musculo-squelettiques et élaborés par Cizeta Medicali. Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et suivre les recommandations pour un bon usage. L'évaluation de la conformité a été réalisée par auto-certification. Les produits Cizeta ortò sont inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévus à l'article L.165-1 du code de la Sécurité Sociale. Juillet 2017 - 1735148PRO

Pensez à commander :
Le bloc **Questionnaire Lombalgie** pour une **meilleure délivrance**

Savoir distinguer

douleur
= **contracture des muscles lombaires** (carré des lombes, psoas, paravertébraux)

sciatique
= **compression du nerf sciatique** entraînant en premier une douleur en haut de la fesse, qui peut redescendre **vers le pied**


hernie discale
= **déformation du disque intervertébral** souvent responsable des sciatiques et cruralgies

Pathologie	**Lombalgie en phase aiguë**	**Lombalgie subaiguë**	**Lombalgie chronique**	**Lombalgie de la femme**
Solution ortò CIZETA	**SL 500** ou **SL THERMO**  4 4	**SL 350** ou **SL 500**  1 4	**SL 500** ou **SL 700**  4 5	**SL 350** ou **SL Lady**  1 3
Activité port de charge	**SL 500**	**SL 500**	**SL 700**	**SL Lady**
Activité statique	**SL Thermo**	**SL 350**	**SL 500**	**SL 350**
Protocole de port et durée moyenne	**4** semaines	Port intermittent le jour, si douleur ou activité à risque		
Conseils associés	Continuer les activités de la **vie quotidienne** + porter la ceinture lors des activités professionnelles à risque de **port de charge**	Porter la ceinture lors des activités professionnelles **à risque** de **port de charge** + **étirements** des ischio-jambiers + **gainage**		
				Thermothérapie

PATHOLOGIES ET SOLUTIONS

7 conseils qui font la différence

Thermothérapie



1. Contracture : l'apport de chaleur favorise le **relâchement musculaire**

Renforcement musculaire et gainage

2. Les **muscles abdominaux** ont un rôle très important et leur renforcement est essentiel pour éviter la récidive



3. Le **travail de respiration** favorise le renforcement des abdominaux



Pratiquer la **marche active** et le travail de **respiration** régulièrement

Souplesse


4. Des **ischios-jambiers trop tendus** et un manque de **souplesse du bassin** entraînent une traction trop importante sur le rachis lombaire



Travailler sa souplesse tous les jours permet d'éviter la récidive

Ergonomie

5. Eviter les mauvaises postures en position assise en adaptant la **hauteur du siège et de l'écran** d'ordinateur



6. Préférer les **sièges avec dossier rigide** que les fauteuils lors de douleurs lombaires




7. Lors de port de charge = ne pas se pencher. Favoriser la **flexion de hanches et genoux**



Sciatique en phase aiguë	Lombalgie de la femme enceinte	Fracture tassement stable	Maladie de Schauerman	Cyphose non réductible
SL 700 ou **SL Thermo**  5 4	**SL Maternity**  2	**Corset** d'hyper-extension 		
SL 700	**SL Maternity**			
SL Thermo				
4 semaines	Port intermittent le jour, si douleur ou activité à risque	4 à 12 semaines	Variable selon la croissance	
Porter la ceinture lors des activités professionnelles à risque de **port de charge** + **étirements** des ischio-jambiers + **gainage**	Porter la ceinture même après l'accouchement si douleur	Passage SL 500 par la suite pour rééducation	Réglage à prévoir durant la croissance	
		Thermothérapie + cryothérapie		

LA COLONNE VERTÉBRALE

La colonne vertébrale, ou rachis, est un **empilement d'os articulés appelés vertèbres**. C'est sur la colonne vertébrale que sont fixées les côtes.

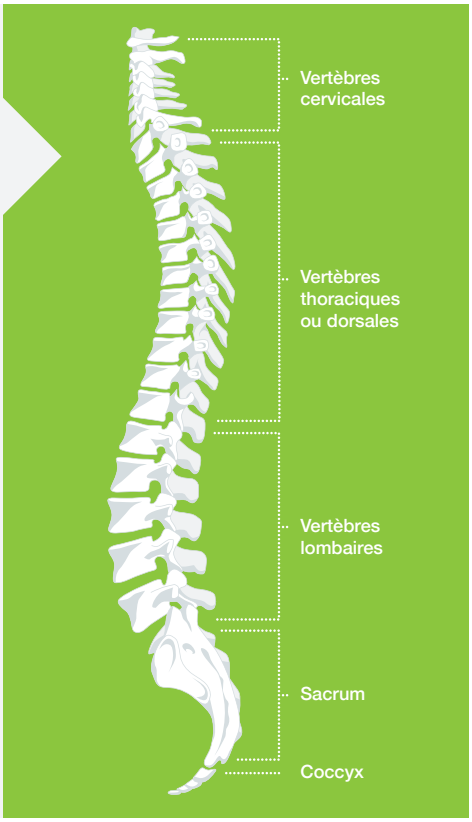



Le rôle du rachis :
- protection de la moelle épinière
- protection des organes internes via les côtes
- garant de la mobilité du corps

Elle est composée de **24 vertèbres** (ou de 33 si l'on compte les vertèbres sacro-coccygiennes soudées) : **7 vertèbres cervicales, 12 thoraciques et 5 lombaires** (plus 5 sacrées et 4 coccygiennes).

Les contraintes importantes du rachis : 70% du poids du corps se trouve au niveau du disque intervertébral L5-S1 sur un peu plus de 6 cm².

Typologie des localisations des lombalgies

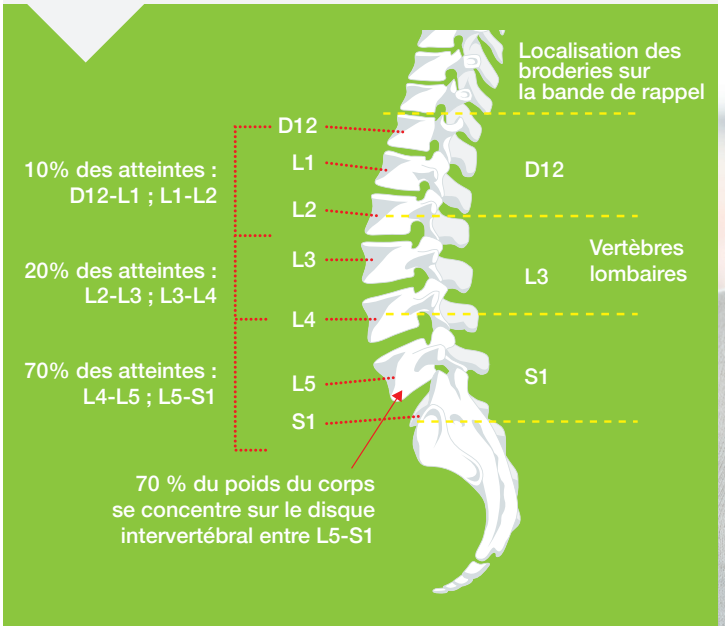

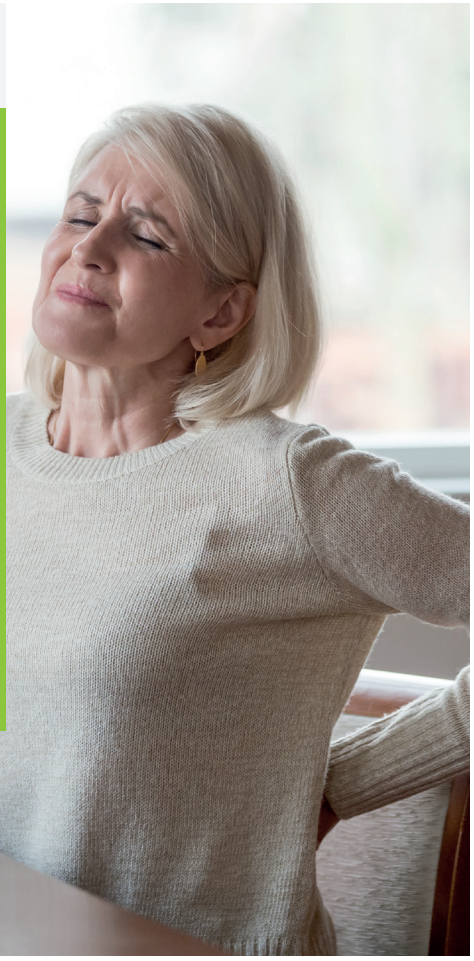

CEINTURE LOMBAIRE

SL LADY

FORCE 3

La ceinture adaptée à la morphologie féminine


La seule ceinture du marché avec une découpe anatomique et une hauteur 26 cm

SL Lady Noir à motif géométrique



PASSE-DOIGTS ERGONOMIQUES
pour une mise en place aisée

Particulièrement adaptée aux femmes à la **TAILLE MARQUÉE**

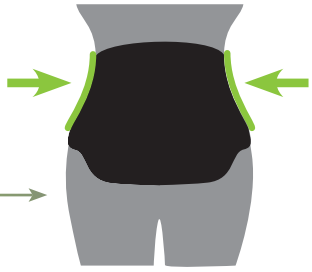



LYCRA® FANTAISIE
au motif géométrique

DOUBLURE LYCRA® :
fin, léger et respirant





SL Lady Gris à motif géométrique

Découpe anatomique incurvée spécialement adaptée à la femme

- Amélioration de l'efficacité ciblée sur la zone lombaire
- Libération des côtes flottantes : aucune gêne en position assise

INDICATIONS :

- Lombalgie subaigüe à chronique de la femme

Tour de taille



Polyamide	Elasthanne	Polyester	Polyuréthane	Polypropylène	Coton
65%	18%	10%	4%	2%	1%

SL LADY - H26 CM — **LPPR : 55,86€TTC / 201E00.022**

Taille	0	1	2	3	4
Tour de taille	60-75 cm	75-90 cm	91-105 cm	106-120 cm	120-135 cm
Référence Gris	3701126326452	3701126326469	3701126326476	3701126326483	3701126326490
Référence Noir	3701126304795	3701126304801	3701126304818	3701126304825	3701126304832

CEINTURE LOMBAIRE

FORCE 4

SL 500

NOUVEAU COLORIS

La ceinture qui cible la douleur



SANGLE AMOVIBLE



ZONES ANATOMIQUES BRODÉES



NOUVEAUTÉ : PASTILLES VELOURS
pour faciliter le serrage de la bande de rappel



TISSU ON STEAM® EN MICROFIBRE RESPIRANT EFFET SECONDE PEAU

SANGLE AMOVIBLE





CONFORT OPTIMUM À MÊME LA PEAU

ZONES ANATOMIQUES IMPRIMÉES



- Sangle amovible permettant de cibler la zone anatomique d'atteinte
- Compression ciblée :
  - dorso-lombalgie (D12-L1 / L1-L2)
  - lombalgie (L2-L3 / L3-L4)
  - lombo-sciatalgie (L4-L5 / L5-S1)
- Découpe anatomique
- Dossard capitonné pour un maintien optimal de la zone dorsale au chaud
- 4 baleines semi-rigides favorisant le Gate Control

INDICATIONS :

- Lombalgie aigües et chronique avec activité modérée

Vidéo de mise en place

disponible sur la chaîne Youtube Cizeta Medicali

Tour de taille



SL 500	Polyamide 47%	Polyester 39%	Elastodiène 11%	Polyuréthane 2%	Coton 1%
SL 500 gris	Polyamide 48%	Polypropylène 20%	Elasthanne 20%	Polyester 8%	Polyuréthane 4%

SL 500 - H 21CM					LPPR : 47,19€TTC / 201E00.021
Taille	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
Tour de taille	60-75 cm	75-90 cm	91-105 cm	106-120 cm	120-135 cm
Référence Noir	3701126319423	3701126319430	3701126319447	3701126319454	3701126319461

SL 500 - H 26CM						LPPR : 55,86€TTC / 201E00.022
Taille	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Tour de taille	60-75 cm	75-90 cm	91-105 cm	106-120 cm	120-135 cm	135 - 150 cm
Référence Noir	3701126318631	3701126318648	3701126318655	3701126318662	3701126318679	3701126300650
NOUVEAU COLORIS Référence Gris	3701126309073	3701126314558	3701126316842	3701126316859	3701126316866	3701126316873

CEINTURE LOMBAIRE

SL THERMO

FORCE 4

La ceinture de thermothérapie

2 POCHES DE GEL




2 packs de gel fournis avec la ceinture

À INSÉRER CHAUD OU FROID







SANGLE AMOVIBLE

NOUVEAUTÉ : PASTILLES VELOURS
pour faciliter le serrage de la bande de rappel



Adaptée aux lombalgies aigües à chroniques et activités modérées de manutention.

Retrouvez toutes les caractéristiques de la SL 500 avec la possibilité d'insérer deux packs gel permettant d'associer l'action d'une ceinture lombaire aux bénéfices de :

- **Thermothérapie :** utilisation de la chaleur favorisant la vasodilatation pour apaiser les tensions musculaires, prévenir et soulager la douleur
- **Cryothérapie :** utilisation du froid dans les cas de déchirures musculaires, contusions et blessures, le froid favorisant la réduction de l'œdème par vasoconstriction

INDICATIONS :

- Lombalgie aigües à chronique. Activité de manutention modérée.



Polyamide	Polyester	Elastodiène	Polyuréthane	Coton
46%	41%	10%	2%	1%

SL THERMO - H 26CM — **LPPR : 55,86€TTC / 201E00.022**

Taille	1	2	3	4
Tour de taille	75-90 cm	91-105 cm	106-120 cm	120-135 cm
Référence	3701126324816	3701126324823	3701126324830	3701126324847

CEINTURE LOMBAIRE

FORCE 5

SL 700

La ceinture qui cible les activités intenses

4 BALEINES RIGIDES
amplifiant l'effet corset





NOUVEAUTÉ : PASTILLES VELOURS
pour faciliter le serrage de la bande de rappel



PASSE-MAINS ERGONOMIQUES
pour une mise en place aisée





- Force du tissu avec la sangle de rappel à 700 cN pour augmenter l'efficacité compressive et antalgique
- Compression ciblée :
  - dorso-lombalgie (D12-L1 / L1-L2)
  - lombalgie (L2-L3 / L3-L4)
  - lombo-sciatalgie (L4-L5 / L5-S1)
- Augmentation accrue du Gate Control et du rappel de posture grâce à la force du tissu associée au dossard capitonné et rigide
- Tissu respirant et résistant adapté aux activités de manutention.

INDICATIONS :
- Lombalgie aigüe et chronique avec activité soutenue



Polyester	Elastodiène	Polyamide	Polyuréthane	Coton
52%	26%	20%	1%	1%

SL 700 - H 26CM — **LPPR : 55,86€TTC / 201E00.022**

Taille	0	1	2	3	4
Tour de taille	60-75 cm	75-90 cm	91-105 cm	106-120 cm	120-135 cm
Référence	3701126320405	3701126320412	3701126320429	3701126320436	3701126320443

CEINTURE LOMBAIRE

FORCE 1

SL 350

La ceinture la plus légère du marché



DÉCOUPES ANATOMIQUES



DOSSARD CAPITONNÉ
pour un maintien optimal
de la zone dorsale au chaud

- Ceinture la plus légère du marché (300g)
- 4 baleines semi-rigides favorisant le Gate Control
- Passe-mains ergonomiques pour une mise en place aisée
- Finitions exclusives Cizeta Ortó

INDICATIONS :
- Lombalgie subaigüe associée à une activité réduite

Tour de taille
mesure : 2 cm au-dessus des crêtes iliaques

Polyamide	Polyester	Elastodiène	Polyuréthane
47%	40%	12%	1%

SL 350 - H 21cm — LPPR : 47,19€TTC / 201E00.021

Taille	0	1	2	3	4
Tour de taille	60-75 cm	75-90 cm	91-105 cm	106-120 cm	120-135 cm
Référence	3701126318532	3701126318549	3701126318556	3701126318563	3701126318570

SL 350 - H 26cm — LPPR : 55,86€TTC / 201E00.022

Taille	0	1	2	3	4
Tour de taille	60-75 cm	75-90 cm	91-105 cm	106-120 cm	120-135 cm
Référence	3701126318587	3701126318594	3701126318600	3701126318617	3701126318624

CEINTURE LOMBAIRE

FORCE 3

LA SL

La ceinture pour la reprise d'activité

TISSU ÉLASTIQUE RÉSISTANT

TISSU RESPIRANT
fin, léger et respirant





DOUBLE SERRAGE
ciblant la zone lombo-sacrée

DÉCOUPE ANATOMIQUE

Ceinture double serrage résistante
- Hauteur 26 cm
- Simplicité du taillage : 3 tailles
- Action ciblée sur la zone lombo-sacrée

INDICATIONS :
- Lombalgie subaigüe
- Lombalgie chronique
- Reprise d'activité

Polyester	Elastodiène	Polyamide
64%	30%	6%

Tour de taille
mesure : 2 cm au-dessus des crêtes iliaques

LA SL - H26 CM — LPPR : 55,86€ TTC / 201E00.022

Taille	1	2	3
Tour de taille	60 - 85 cm	85 - 110 cm	110-135 cm
Référence	3701126306218	3701126306225	3701126306232

CIZETA ortò VARISAN

Future maman

Soulagez
les **douleurs**
de la **grossesse**
naturellement
avec des
solutions **simples**

Demandez
votre **guide gratuit**
à votre pharmacien



Soulager mon dos



Ceinture **SL Maternity**

Diminuer mon œdème



Mi-bas **DEMA**

Enfiler mes bas



Enfile-bas **Varitec®**

CIZETA MEDICALI 1872
SCIENCE & MEDICAL QUALITY

CEINTURE LOMBAIRE

SL MATERNITY

FORCE 2

La ceinture adaptée aux lombalgies de la femme enceinte

DÉCOUPE ANATOMIQUE
spécifique aux évolutions morphologiques de la grossesse



ZONES ANATOMIQUES BRODÉES





PASSE-MAINS ERGONOMIQUES
pour une mise en place aisée



- Compression ciblée :
  - dorso-lombalgie (D12-L1 / L1-L2)
  - lombalgie (L2-L3 / L3-L4)
  - lombo-sciatalgie (L4-L5 / L5-S1)
- Tissu aéré léger
- Dossard capitonné pour un maintien optimal de la zone dorsale au chaud
- 4 baleines semi-rigides favorisant le Gate Control
- Passe-mains ergonomiques pour une mise en place aisée
- Finitions exclusives : zones anatomiques brodées
- Lycra sur la partie dos pour limiter la transpiration et doublure jersey-coton velours pour plus de confort

INDICATIONS :
- Douleurs lombaires liées à la grossesse

Vidéo de mise en place



disponible sur la chaîne Youtube Cizeta Medicali

Tour de ventre
mesure : au plus fort



Polyamide 47%	Polyester 19%	Polyuréthane 13%
Elasthanne 9%	Coton 7%	Elastodiène 5%

SL MATERNITY - H 26CM	LPPR : 55,86€TTC / 201E00.022	
Taille	1	2
Tour de ventre	90-120 cm	115-135 cm
Référence	3701126320603	3701126320610

Pour la femme enceinte, pensez à :

(1)

DEMA®
CLASSE 2
15-20 mmHg

Conseiller DEMA® 2 la compression spécifique à l'œdème

(2)



Faciliter l'enfilage des chaussettes de compression avec Varitec®

(3)



Soulager les maux de l'hyperlordose avec SL Maternity



Retrouvez tous nos conseils dans le Livret Patiente Grossesse, à commander auprès de votre délégué

CEINTURE ABDOMINALE

HYPOGRIPP

La ceinture de maintien abdominal



PATTE HYPOGASTRIQUE AMOVIBLE



- Tissu microfibre aéré
- Double réglage devant

INDICATIONS :

- Lumbago
- Sciatique (port continu)
- Déficience de la paroi abdominale
- Arthrose lombaire



Polyamide 47% | Polyester 27% | Elastodiène 26%


HYPOGRIPP - H 25 CM					LPPR : 71,90€TTC / 201E00.032
Taille	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Tour de taille	75 - 90 cm	91 - 105 cm	106 - 120 cm	120 - 140 cm	140 - 160 cm
Référence	3701126312790	3701126312806	3701126312813	3701126316897	3701126316903

NOUVELLES TAILLE

CORSET DE JEWETT ARTICULÉ

CORSET D'HYPER-EXTENSION

Un corset efficace facile à adapter

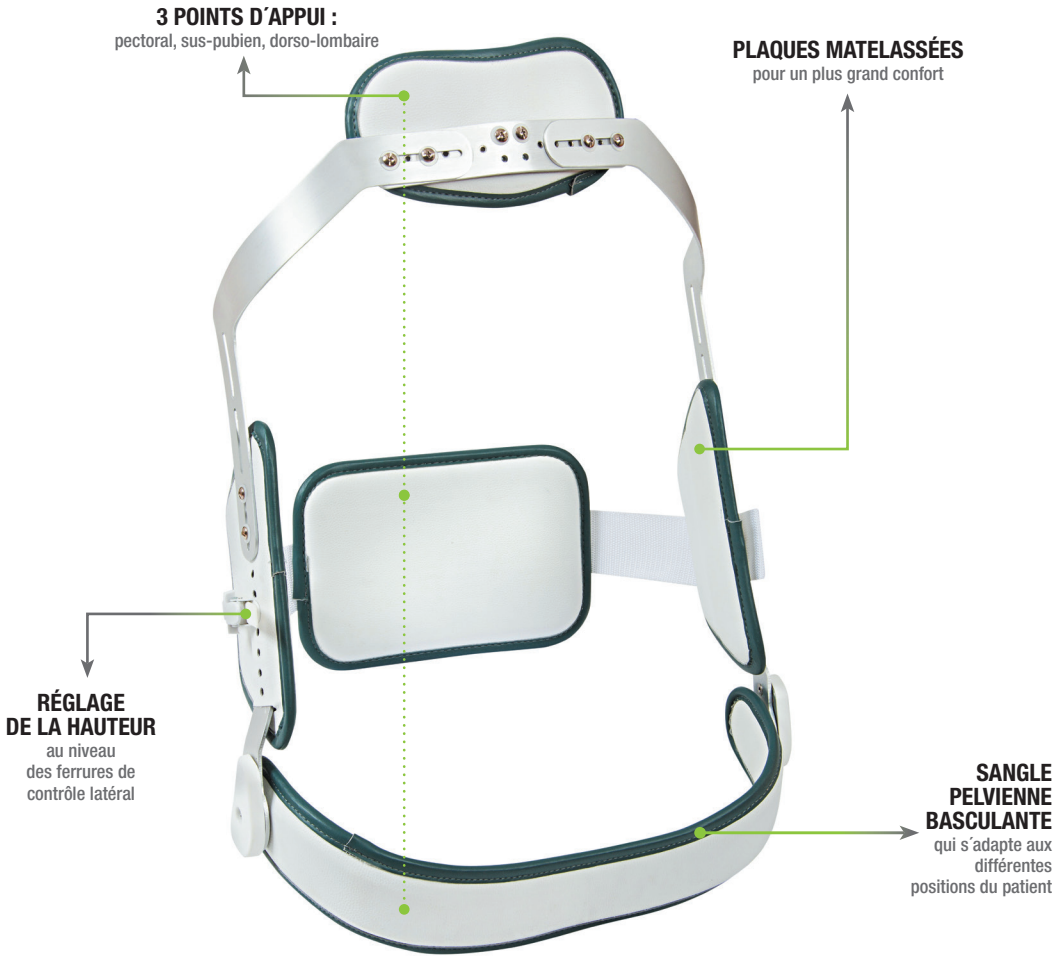

- Structure légère en aluminium
- Plaque sternale amovible
- Plaque de tension dorso-lombaire réglable par sangle et système de fermeture

Reportez-vous à la notice pour le réglage de la ceinture

CONTRE-INDICATION :

- Cyphose irréductible

INDICATIONS :

- Maladie de Scheuermann
- Attitude cyphotique
- Fractures vertébrales stables de la colonne dorsale basse et de la colonne lombaire
- Douleurs vertébrales pour cause de métastases secondaires
- Immobilisation à moyen terme après chirurgie du disque intervertébral
- Traitements post-opératoires après chirurgie de la colonne par décompression avec ou sans fixation interne



Aluminium 60%	Polyamide 15%	Polychlorure de vinyle 10%	Polyuréthane 10%	Polypropylène 3%	Polyoxyméthylène 2%


CORSET D'HYPER-EXTENSION BLANC				LPPR : 89,70€TTC / 201E 00.041
Taille	**1**	**2**	**3**	**4**
Tour de hanche	60-75 cm	75-90 cm	90-105 cm	105-115 cm
Hauteur (du V sternal au bassin)	39-46 cm	42-49 cm	45-52 cm	49-56 cm
Référence	3701126301954	3701126301961	3701126301978	3701126301985

CIZETA ortò



RACHIS CERVICAL



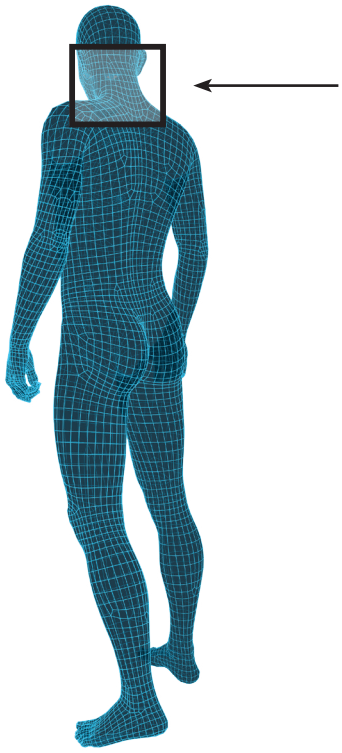

COMMENT BIEN DÉLIVRER UN COLLIER CERVICAL ?



PRISE DE MESURE :

1. Hauteur : distance du V. Sternal jusqu'à la base du menton.
2. Tour de cou en prenant la base du cou de préférence (partie la plus large).
3. Essayage et mise en place
   - Mettre en place le collier.
   - Vérifier si le regard est dirigé vers l'horizon pour valider la hauteur du produit.
   - Valider le confort du patient.

COLLIERS CERVICAUX

ANATO C1 28
ANATO C2 28
ANATO C3 29
ANATO C4 29


A R B R E D É C I S I O N N E L

Soutien léger	Soutien semi-rigide	Immobilisation modérée	Immobilisation stricte
Torticolis Arthrose cervicale	Névralgie cervico-brachiale Arthrose cervicale	Névralgie cervico-brachiale Entorse bénigne Entorse moyenne	Entorse moyenne Entorse grave
ANATO C1	ANATO C2	ANATO C3	ANATO C4
			
p.28	p.28	p.29	p.29

COLLIER CERVICAL

ANATO C1

Soutien antalgique souple du rachis cervical

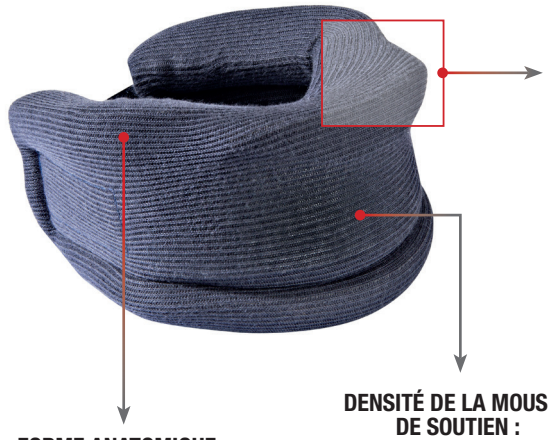

- Collier de moyenne densité optimisé pour un port prolongé, conservant sa qualité dans le temps

INDICATIONS :

- Torticolis
- Cervicalgie aigüe sans traumatisme
- Cervicarthrose en phase chronique
- Sevrage progressif après port d'une immobilisation plus rigide

CONTRE-INDICATIONS :

- Traumatisme cervical grave

ANATO C1			LPPR : 9,25€TTC / 7110306
Taille	**1**	**2**	**3**
Tour de cou	28-33 cm	34-39 cm	40-45 cm
Hauteur 8 cm	3701126307772	3701126307789	3701126307796
Hauteur 10 cm	3701126307802	3701126307819	3701126307826

Polyuréthane 66%	Coton 26%	Polyamide 8%

COLLIER CERVICAL

ANATO C2

Soutien antalgique semi-rigide du rachis cervical



- Renfort intégré inamovible en plastique
- Densité de mousse de soutien : 30kg/m³ pour un soutien antalgique semi-rigide

INDICATIONS :

- Cervicalgie aigüe sans traumatisme
- Cervicarthrose en phase hyperalgique
- Névralgie cervico-brachiale arthrosique
- Entorse bénigne à moyenne

CONTRE-INDICATIONS :

- Traumatisme cervical grave

ANATO C2			LPPR : 13,10€TTC / 7110312
Taille	**1**	**2**	**3**
Tour de cou	28-33 cm	34-39 cm	40-45 cm
Hauteur 8 cm	3701126307833	3701126307840	3701126307857
Hauteur 10 cm	3701126307864	3701126307871	3701126307888

Polyuréthane 52%	Coton 20%	Polypropylène 20%
Polyamide 6%	Polyéthylène 1%	Acrylique 1%

COLLIER CERVICAL

ANATO C3

Soutien renforcé du rachis cervical



CONTOUR ET APPUI MENTONNIER
recouverts d'un similicuir avec une mousse intérieure en polyuréthane assurant un confort optimum.

RÉGLAGE EN HAUTEUR
par velcro de 6 à 13 cm



- Structure en polyéthylène renforcé et aéré
- Radio-transparent

INDICATIONS :
- Traumatisme cervical
- Entorse moyenne à grave
- Névralgie cervico-brachiale traumatique

CONTRE-INDICATIONS :
- Traumatisme cervical grave qui nécessiterait une immobilisation plus rigide avec un collier C4


ANATO C3				LPPR : 15,71€TTC / 7110335
Taille	**1**	**2**	**3**	**4**
Tour de cou	25-30 cm	30-35 cm	35-40 cm	40-45 cm
Hauteur	6-9 cm	7,5-10,5 cm	9-12 cm	10-13 cm
Référence	3701126301749	3701126301763	3701126301770	3701126301787

Polyéthylène basse densité 60%
Polyuréthane 20%
Polychlorure de vinyle 15%
Polyamide 5%

COLLIER CERVICAL

ANATO C4

Soutien rigide à 4 appuis du rachis cervical

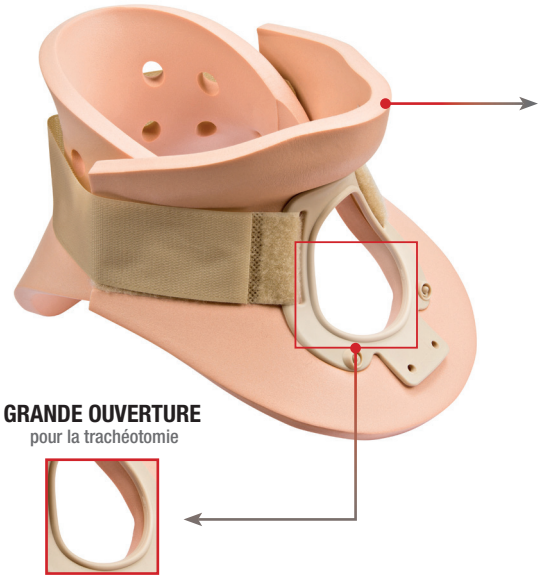

MENTONNIÈRE
permettant de limiter les mouvements de la tête

GRANDE OUVERTURE
pour la trachéotomie



- Constitué de deux parties anatomiques en mousse EVA permettant d'associer résistance aux chocs et souplesse
- Appui mentonnier, occipital, dorsal et sternal
- Réajustable au pistolet thermique
- Radio-transparent

INDICATIONS :
- Traumatisme cervical grave
- Entorse grave

CONTRE-INDICATIONS :
- Allergie à la matière EVA


ANATO C4				LPPR : 18,77€TTC / 7110341
Taille	**1**	**2**	**3**	**4**
Tour de cou	25-33 cm	33-41 cm	41-46 cm	46-48 cm
Hauteur 8 cm	3701126301831	3701126301848	3701126301855	3701126301862
Hauteur 11 cm	3701126301879	3701126301886	3701126301893	3701126301909

Mousse EVA 85%
Polyamide 15%

ortò CIZETA



ÉPAULE BRAS

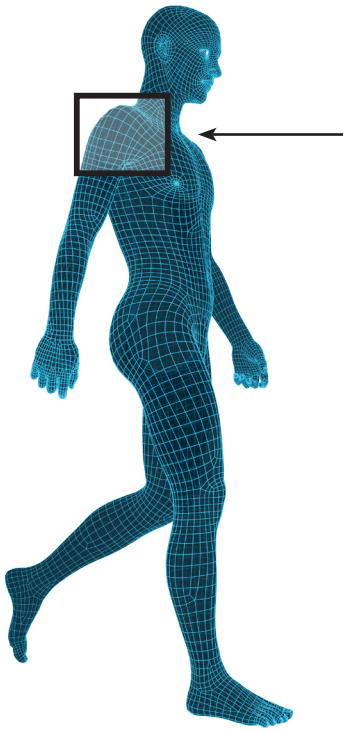

COMMENT BIEN DÉLIVRER UN GILET D'IMMOBILISATION ?





1. PRISE DE MESURE :
   Tour de poitrine ou distance coude-main pour le gilet d'immobilisation
2. ESSAYAGE ET MISE EN PLACE
   - libérer la main et le poignet pour favoriser le retour veineux.
   - coude fléchi au minimum à 90° pour faciliter le retour veineux.
   - ajuster le serrage pour favoriser le relâchement de l'épaule.

Montrer la mise en place sur vous-même puis laisser le patient positionner le gilet et corriger si besoin.

GILETS D'IMMOBILISATION

PERFO BRAS 32
COUSSIN D'ABDUCTION 20° 33
GILET D'IMMOBILISATION 34
ANNEAU CLAVICULAIRE 35
POLYVESTE 35

A R B R E D É C I S I O N N E L

IMMOBILISATION ÉPAULE

GILET D'IMMOBILISATION



p.34

PERFO BRAS



p.32

ANNEAU CLAVICULAIRE



p.35

POLYVESTE



p.35

COUSSIN D'ABDUCTION 20°



p.33


EPAULE / BRAS


PERFO BRAS


Modèle bilatéral

Immobilisation efficace et confortable



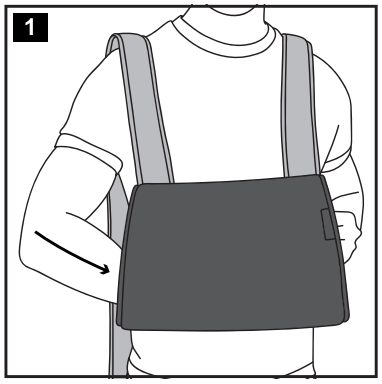

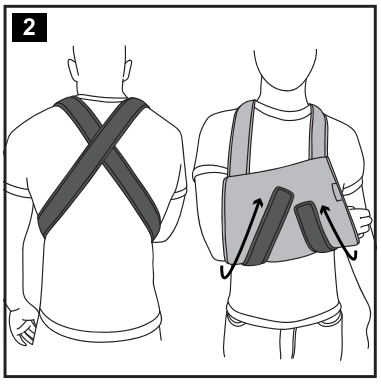

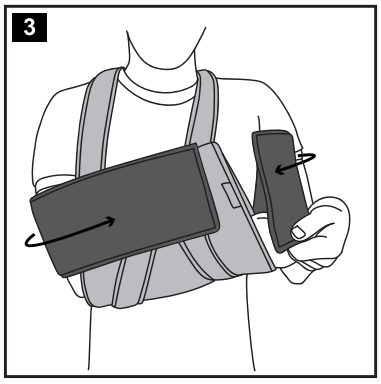

- Confort de la mousse macro-perforée
- Confort d'usage et qualité d'immobilisation

INDICATIONS :

- Traumatologie du membre supérieur (luxation, fracture...)
- Neurologie : paralysie, hémiplégie
- Post-opératoire
- Rupture coiffe des rotateurs



Polyuréthane	Coton	Polyamide
48%	30%	22%

PERFO BRAS		LPPR : 15,24€TTC / 6110468	
Taille	**1**	**2**	**3**
Tour de poitrine	90-105 cm	105-120 cm	120-135 cm
Référence	3701126309035	3701126309042	3701126309059

Vidéo de mise en place

disponible sur la chaîne Youtube Cizeta Medicali

EPAULE / BRAS

COUSSIN D'ABDUCTION 20°

Modèle bilatéral


Une immobilisation ajustée, confortable





SANGLE RÉGLABLE
en hauteur par boucle pour un ajustement optimum

LANGUETTE DE SOUTIEN
du pouce

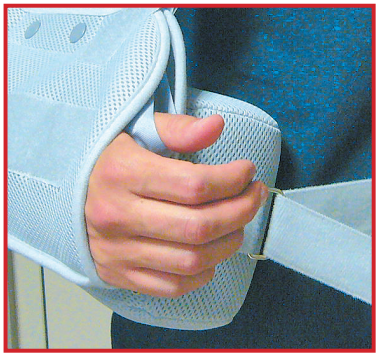

- Permet de placer le bras dans plusieurs positions selon les exigences post-opératoires
- Limitation de rotation interne de l'épaule
- Stabilisation et confort grâce au coussin de forme anatomique ajustable
- Maille 3D côté extérieur et tissu éponge côté peau évacuant l'humidité pour plus de confort et un port prolongé
- Grande facilité de mise en place

CONTRE-INDICATIONS :
- Allergie aux matières textiles
- Non adapté pour angulation souhaitée plus importante, au-delà de 20°

INDICATIONS :
- Maintien post-traumatique ou post-opératoire de l'épaule
- Chirurgie de la coiffe des rotateurs opérée
- Déplacement de la capsule articulaire
- Procédure post-opératoire de Bankart
- Luxation et subluxation de l'articulation gléno-humérale
- Distension et réparation des tissus mous

COUSSIN D'ABDUCTION 20°	LPPR : 15,24€TTC / 6110468
Taille	Unique
Référence	3701126302098

Polyuréthane 70%	Polyester 20%	Polyamide 10%	Nickel (boutons-pression)

EPAULE / BRAS

EPAULE / BRAS

GILET D'IMMOBILISATION

Modèle bilatéral

Immobilisation efficace et respirante



- Support de bras confortable grâce à sa sangle capitonnée au niveau de l'épaule

INDICATIONS :

- Maintien post-traumatique ou post-opératoire du coude et de l'avant-bras
- Soutien et maintien du bras, coude au corps
- Immobilisation du membre supérieur sans immobilisation stricte de l'épaule
- Subluxation gléno-humérale chez le patient hémiplégique
- Support d'un plâtre



Coton	Polyester	Polyamide	Polyuréthane
50%	20%	20%	10%

GILET D'IMMOBILISATION				LPPR : 15,24€TTC / 6110468
Taille	**1**	**2**	**3**	**4**
Distance coude-main	28-36 cm	35-42 cm	41-49 cm	48-56 cm
Référence	3701126301992	3701126302005	3701126302012	3701126302029

EPAULE / BRAS

ANNEAU CLAVICULAIRE

Pour la fracture de la clavicule



- Sangle acromio-claviculaire avec un système d'attaches dorsales auto-agrippantes
- Maintien réglable de la traction
- Confortable grâce aux épaulières molletonnées et de la sangle capitonnée au niveau de l'épaule

INDICATIONS :

- Fracture ou traumatisme de clavicule avec ou sans déplacement
- Luxation de l'articulation acromio-claviculaire

ANNEAU CLAVICULAIRE				Non remboursé par la sécurité sociale
Taille	**1**	**2**	**3**	**4**
Largeur épaules	23-28 cm	28-36 cm	36-45 cm	45-54 cm
Référence	3701126302036	3701126302043	3701126302050	3701126302067




Polyuréthane 30%
Polyamide 30%
Polyester 20%
Coton 20%

EPAULE / BRAS

POLYVESTE

L'immobilisation modulable de l'épaule

Modèle bilatéral

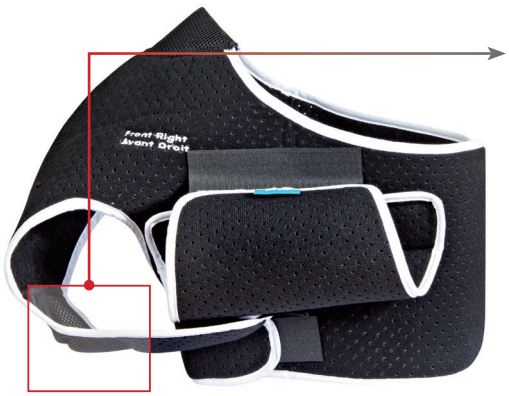

EMPIÈCEMENT COUDE
et mousse macro-perforée pour un meilleur confort



- Immobilisation supérieure de l'épaule
- Système de mise en place spécifique réglable permet une parfaite immobilisation de l'épaule et du bras en position coude au corps
- Matière respirante : port confortable

INDICATIONS :

- Traumatologie du membre supérieur (luxation, fracture...)
- Neurologie : paralysie, hémiplégie
- Post-opératoire
- Rupture coiffe des rotateurs

Vidéo de mise en place

disponible sur la chaîne Youtube Cizeta Medicali




Polyuréthane 80%
Polyester 10%
Polyamide 5%
Coton 5%

POLYVESTE					LPPR : 15,24€TTC / 6110468
Taille	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
Tour de poitrine	65-75 cm	70-80 cm	75-90 cm	90-105 cm	105-125 cm
Référence	3701126319416	3701126314169	3701126314176	3701126314183	3701126314190



MAIN POIGNET

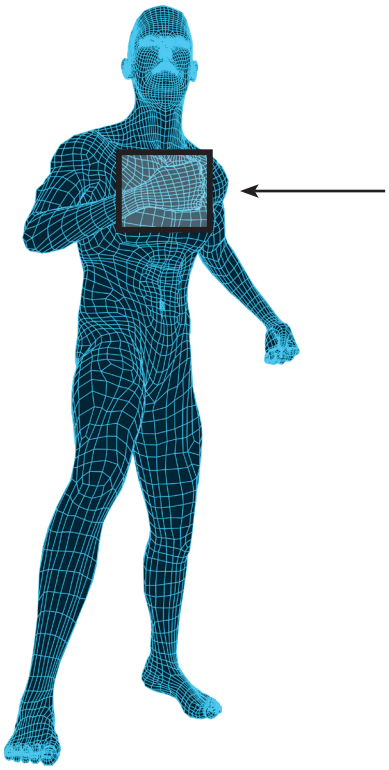

COMMENT BIEN DÉLIVRER UNE ATTELLE MAIN-POIGNET ?



1. PRISE DE MESURE :
   - Tour de poignet en amont des styloïdes radiale et ulnaire (se référer au tour de montre)
   - Si le poignet est œdématié, mesurer l'autre poignet.
2. ESSAYAGE ET MISE EN PLACE :
   - Ajuster l'éclisse face palmaire en regard de l'arche interne de la main (creux de la main).
   - Ajuster l'angulation de l'éclisse en fonction de l'angulation desirée.
   - Ajuster le serrage en fonction du patient.

GAMME ATL SEAMLESS
ATL SEAMLESS POIGNET 40
ATL SEAMLESS POUCE 41

MAIN
MI 70 42

GAMME PERFO
PERFO POIGNET 43
PERFO POIGNET POUCE 43

A R B R E D É C I S I O N N E L

Rhumatologie — **Traumatologie** — **Traumatologie grave**


Gamme ATL SEAMLESS		Gamme PERFO		MAIN
ATL SEAMLESS POUCE	ATL SEAMLESS POIGNET	PERFO POIGNET	PERFO POIGNET POUCE	MI 70
				
p.41	p.40	p.43	p.43	p.42

PATHOLOGIES ET SOLUTIONS

Le saviez-vous ?

La main et le poignet :
- 27 os répartis en 3 zones : le carpe, le métacarpe et les doigts
- 20 muscles dans la main + muscles de l'avant-bras
- + de 120 ligaments stabilisent la main et le poignet

Rhizarthrose :
Atteinte dégénérative de **l'articulation trapézo-métacarpienne**, entrainant une **perte de la pince** pouce-index avec douleur et parfois perte de force. L'immobilisation a un rôle essentiel dans la limitation de la douleur et des déformations.

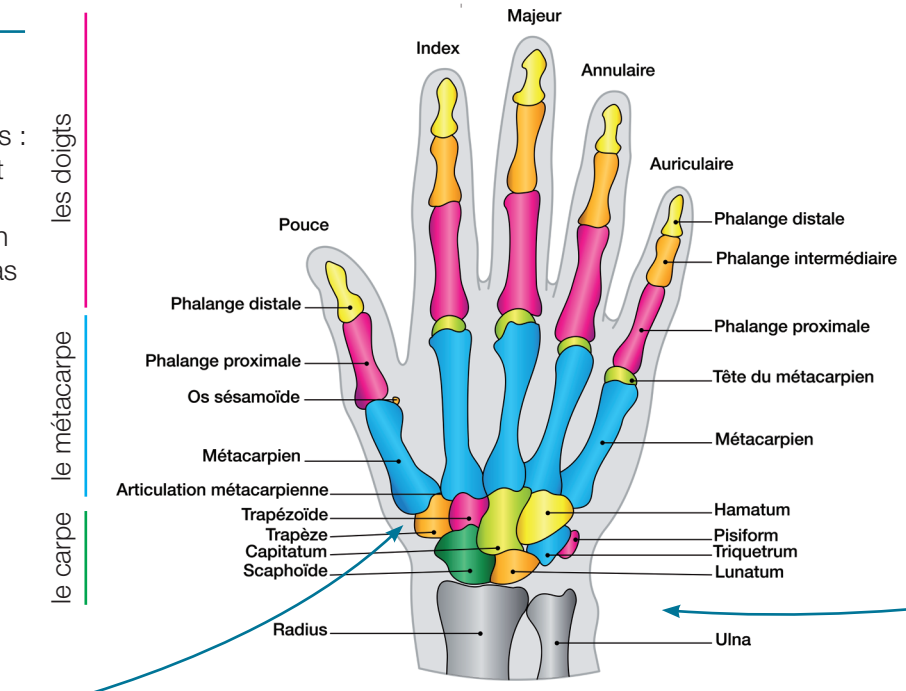

Anatomie du squelette
Main droite face dorsale

ARTHROSE ET TMS*

	Rhizarthrose		Tendinopathie				Syndrome du canal carpien	
Pathologie	débutante fonctionnelle	en phase inflammatoire	de Quervain (tendinite du pouce)	des doigts	du poignet	Epicondylite		Pouce
Solution ortho CIZETA	ATL Seamless Pouce 	ATL Seamless poignet + pouce en journée 	ATL Seamless poignet + pouce 	ATL Seamless poignet 		ATL Seamless poignet 	ATL Seamless poignet 	ATL Seamless pouce 
Protocole de port	☀	☾		☀			☾	
Durée	15 jours selon la douleur et durant les activités	3 semaines	4 semaines				6 semaines	
Conseils associés	Apport de chaleur et exercices d'étirement lents d'ouverture du pouce		Exercices d'étirement de la colonne du pouce	Exercices d'étirement du poignet en extension et flexion		Étirement du poignet en extension, régulièrement	Glaçage régulier si douleur	

* TMS : trouble musculo-squelettique

PATHOLOGIES ET SOLUTIONS

Epicondylite* : appelé **« tennis elbow »**


Douleur localisée au niveau du **coude** au niveau des insertions des muscles épicondyliens (permettant l'extension du poignet).
Cause principale : **sollicitation trop importante du poignet.**

Syndrome du canal carpien :

Douleur de la main (face interne) plutôt **nocturne** avec **perte de force** et **fourmillement** pouce, index et majeur.
Fréquent chez la **femme enceinte**, travail de **force** avec **gestes répétitifs**,...

Les conseils qui font la différence

dans le cas de…



Arthrose, polyarthrite :

- L'apport de **chaleur** permet de soulager l'articulation atteinte et redonne de la **mobilité** le matin.



Tendinopathie / Tendinite :

- L'apport de **glace** permet de soulager la zone inflammatoire.
- Conseiller de faire des **étirements** :
  - pendant 2 à 3 min
  - 4 fois par jour associés à la rééducation



Traumatismes :

- Le glaçage permet de favoriser la **réduction de l'œdème.**
- Mettre la main en **position de déclive** en position allongée et porter une écharpe pour maintenir la main au-dessus du niveau du coude.
- A partir de la 2ème semaine, le patient peut commencer sa **rééducation avec une balle molle**, après validation médicale.



TRAUMATOLOGIE

Entorse					Fracture	Chirurgie	
Bénigne à moyenne		**Grave**			**Fracture métacarpien non déplacée ou post-op**	**Relais plâtre**	
Poignet	Poignet + pouce	Pouce	Poignet	Poignet + pouce		Poignet	Poignet + pouce
ATL Seamless poignet	ATL Seamless poignet + pouce	Perfo poignet pouce	Perfo poignet	Perfo poignet pouce	MI 70®	ATL Seamless poignet	ATL Seamless poignet + pouce
							
nuit et jour 							
2 à 4 semaines		4 à 6 semaines			2 à 4 semaines		
Glaçage 4 fois/jour pendant 20 min avec une poche de gel placée au congélateur					Glaçage 4 fois/jour pendant 20 min. Masser les extrémités des doigts	Glaçage 4 fois/jour pendant 20 min	

ATTELLES MAIN / POIGNET

ATL SEAMLESS POIGNET ÉVOLUTION

Attelle poignet avec immobilisation du pouce amovible

1 attelle poignet pour 3 types de pathologies



- 2 en 1 : la seule attelle avec Immo Pouce amovible pour s'adapter aux temps de cicatrisation différents du poignet et du pouce, en favorisant la rééducation précoce du pouce
- Tissu respirant avec découpe anatomique
- Baleines aluminium amovibles radiotransparentes
- Modèle droit et gauche

INDICATIONS :

- Traumatismes du poignet et du pouce (avec accessoire pouce)
- Entorses du poignet ou poignet-pouce (avec accessoire pouce)
- Relais post-plâtre
- Tendinopathie du poignet ou poignet-pouce (avec accessoire pouce) : tendinite de De Quervain
- Syndrome du canal carpien
- Arthrose du poignet ou poignet-pouce (avec accessoire pouce)
- Polyarthrite rhumatoïde

Vidéo de mise en place



disponible sur la chaîne Youtube Cizeta Medicali





Polyuréthane	Polyamide	Coton	Elasthanne
44%	30%	23%	3%

ATL SEAMLESS POIGNET	LPPR : 56,64€TTC / 7110476	
Taille	**1**	**2**
Tour de poignet	14-18 cm	18-22 cm
Référence Poignet Droit	3701126323949	3701126323956
Référence Poignet Gauche	3701126323970	3701126323963

ATTELLES MAIN / POIGNET

ATL SEAMLESS POUCE

Modèle bilatéral

ÉVOLUTION

Immobilisation et mise au repos de la colonne du pouce



- Tissu respirant avec découpe anatomique
- Baleines aluminium radiotransparentes

INDICATIONS :

- Immobilisation du pouce et de la colonne du pouce en post-traumatique
- Rhizarthrose du pouce en phase hyperalgique



Polyuréthane	Polyamide	Coton	Elasthanne
44%	30%	23%	3%

Vidéo de mise en place



disponible sur la chaîne Youtube Cizeta Medicali

ATL SEAMLESS POUCE	LPPR : 43,32€TTC / 7110482	
Taille	**1**	**2**
Tour de poignet	14-18 cm	18-22 cm
Tour de pouce	5-7 cm	6-8 cm
Référence	3701126323987	3701126323994

ATTELLES MAIN / POIGNET

MI 70

MODÈLE BREVETÉ

La nouvelle génération d'attelle d'immobilisation pour la fracture des métacarpiens

SYNDACTYLIE
du 2ème et 3ème doigt ou 4ème et 5ème doigt





APPUI ET CONTRE-APPUI
en face palmaire et dorsale, amovibles et réglables



Immobilisation de l'articulation métacarpophalangienne
EN POSITION INTRINSÈQUE (FLEXION 70°)



- Sans enfilage, mise en place intuitive et sans douleur
- Réglable en fonction des atteintes et ajustable du 2e au 5e métacarpien
- Liberté des articulations inter-phalangiennes : possibilité de garder la préhension
- Une seule orthèse pour les atteintes des métacarpiens
- Légère (seulement 61 grammes) respirante, confortable

INDICATIONS :

- Luxation métacarpo-phalangienne
- Entorse métacarpo-phalangienne
- Fracture du col des 2e, 3e, 4e et 5e métacarpiens
- Fracture diaphysaire des 2e, 3e, 4e et 5e métacarpiens





Polyamide	Polyuréthane	Elastomère	Coton
77%	12%	10%	1%

Vidéo innovation



Disponible sur la chaîne Youtube Cizeta Medicali

MI 70	LPPR : 79,20€TTC / 7110387	
Taille	**1**	**2**
Tour de main	16-21,5 cm	21-27 cm
Référence Main Droite	3701126326803	3701126326810
Référence Main Gauche	3701126326827	3701126326834

ATTELLES MAIN / POIGNET

PERFO POIGNET

Immobilisation rigide du poignet

Modèle bilatéral



- Facilité d'usage et immobilisation renforcée
- Mousse macro-perforée pour plus de confort

INDICATIONS :

- Poignet traumatique (entorse, fracture)
- Immobilisation post-opératoire

PERFO POIGNET			LPPR : 56,64€TTC / 7110476
Taille	**1**	**2**	**3**
Tour de poignet	< 17 cm	17-20 cm	> 20 cm
Référence	3701126312943	3701126312950	3701126312967



Polyuréthane 48% | Coton 30% | Polyamide 22%

ATTELLES MAIN / POIGNET

PERFO POIGNET POUCE

Immobilisation rigide du poignet-pouce

Modèle bilatéral



- Colonne du pouce réglable et ajustable
- Facilité d'usage et immobilisation renforcée
- Mousse macro-perforée pour plus de confort

INDICATIONS :

- Poignet pouce traumatique (entorse, fracture)
- Immobilisation post-opératoire du poignet pouce

PERFO POIGNET POUCE			LPPR : 53,18€TTC / 7110499
Taille	**1**	**2**	**3**
Tour de poignet	< 17 cm	17-20 cm	> 20 cm
Référence	3701126309080	3701126309097	3701126309103



Polyuréthane 48% | Coton 30% | Polyamide 22%


MAIN / POIGNET

NOUVEAUTÉS 2022

NOUVEAUTÉS 2022



GENOU

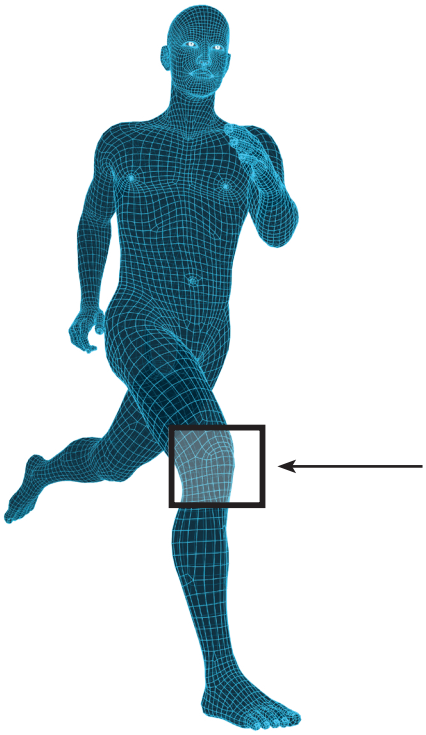

COMMENT BIEN DÉLIVRER UNE GENOUILLÈRE ?





PRISE DE MESURE :

- Mesurer la circonférence du genou semi-fléchi, au milieu de la rotule.
- Si le genou est œdématié, mesurer l'autre genou.
- Pour la gamme élastique, prendre le tour de cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

GENOUILLÈRES

GL 120 STANDARD 50
GL 120 OPEN 51
GL STAB 52
PATELLA STAB 53
GL STRAPP 53

ATTELLES DE GENOU

CIROM 54
PERFO UNI 3 55

ARBRE DÉCISIONNEL

Besoin de maintien → **Reprise sportive et phase de rééducation**

MAINTIEN LÉGER	MAINTIEN RENFORCÉ	MAINTIEN INTENSE
GL Stab	Patella Stab	GL Strapp
		
p.52	p.53	p.53

Reprise sportive et phase de rééducation → **Immobilisation et Post-Op**

PHASE RÉÉDUCATION INSTABILITÉ CHRONIQUE		POST-OP LCA ET RÉÉDUCATION	IMMOBILISATION APRÈS TRAUMATISME
GL 120 Standard	GL 120 Open	CIROM	Perfo Uni 3
			
p.50	p.51	p.54	p.55

PATHOLOGIES ET SOLUTIONS


Le saviez-vous ?

Le genou :
Une articulation complexe qui supporte 80% du poids du corps lors de la marche.

Il se compose de 2 articulations :
- Articulation fémoro-tibiale
- Articulation fémoro-patellaire

Sa grande stabilité réside dans l'association :
- Des 4 ligaments puissants : LCM, LCA, LCP, LCL
- Du complexe ménisques-condyles fémoraux (articulation fémoro-tibiale)
- Des groupes musculaires puissants

La patella (rotule) a un rôle essentiel :
- Dans la stabilisation du genou (verrouillage)
- De poulie du muscle quadriceps

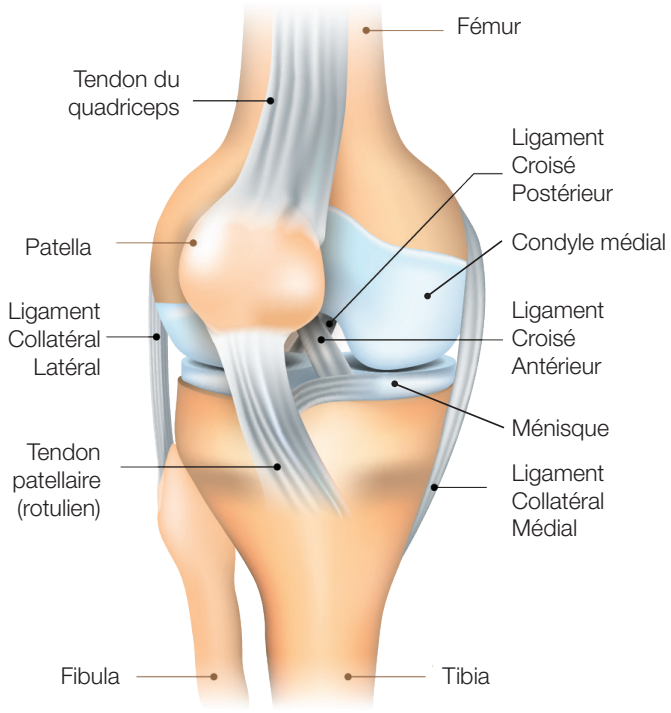


Anatomie du genou

Pathologie	Instabilité fonctionnelle	Hydrarthrose (épanchement de synovie)	Syndrome fémoro-patellaire (rotulien)		Osgood Schlatter		Subluxation et luxation fémoro-patellaire	
Solution	Gamme élastique	GL Stab	Patella Stab	GL Strapp	Patella Stab	GL Strapp	Patella Stab	GL Strapp
								
Protocole de port	Pendant les activités sportives	Pendant 2 semaines	Pendant les activités sportives		Arrêt sport durant une longue période			
Reprise d'activité sportive	Reprise sportive orientée vers la proprioception	Après réduction de l'hydrarthrose, reprise progressive	Reprise sportive orientée vers la proprioception et recentrage actif de la patella		Reprise progressive suivant les recommandations du médecin		Reprise sportive orientée vers la proprioception et recentrage actif de la patella	
Conseils associées	• Pack de froid • Semelle amortissante en gel		• Pack de froid				• Pack de froid • Crème anti-inflammatoire	

PATHOLOGIES ET SOLUTIONS

Instabilité du genou : le travail de proprioception

selon les recommandations de votre médecin

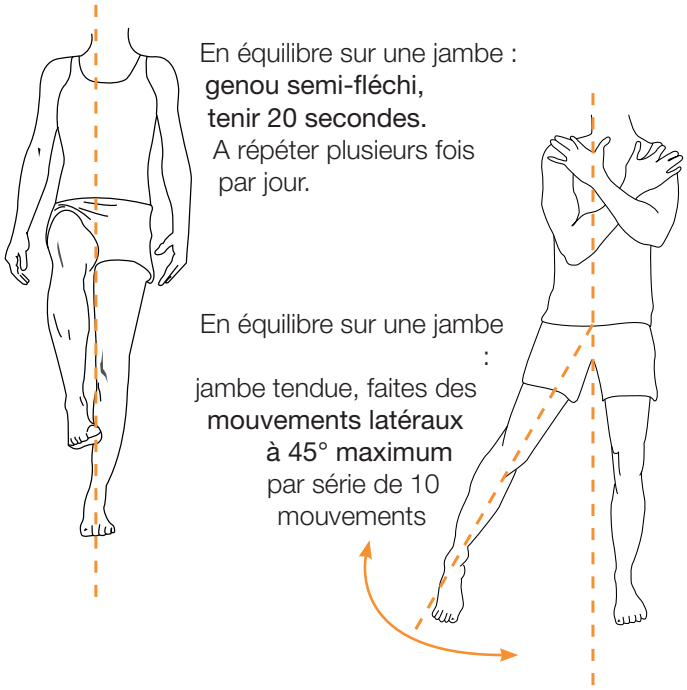

En équilibre sur une jambe : **genou semi-fléchi, tenir 20 secondes.** A répéter plusieurs fois par jour.

En équilibre sur une jambe :

jambe tendue, faites des **mouvements latéraux à 45° maximum** par série de 10 mouvements

Les conseils qui font la différence

Le chaussage :

- Une bonne paire de baskets pour la pratique du sport permet d'éviter les traumatismes du genou
- En cas d'**arthrose**, choisir une semelle qui absorbe les vibrations et chocs
- En cas **d'œdème** : cryothérapie 20 min minimum

- Après toute **intervention chirurgicale** : port de la compression pour éviter la thrombose veineuse (phlébite)



Tendinopathie		Lésion méniscale		Gonarthrose		Entorse moyenne à grave du genou		Rupture LCA		Fracture du genou
Patella Stab	GL Strapp	GL 120	CIROM	GL Strapp	GL 120	GL 120	CIROM	CIROM	GL 120	Perfo Uni 3
										
								en fonction de l'intervention		en fonction de l'intervention ou en relais après immobilisation résine
Reprise progressive et rééducation pour éviter la récidive		Reprise sportive 6 semaines en fonction des atteintes associées		Impérativement marcher sans charge. Perdre du poids.		Reprise sportive 6 semaines en fonction des atteintes associées		Minimum 12 semaines après la rééducation		
• Pack de froid • Crème anti-inflammatoire		En stade plus avancé, conseiller une canne de marche • Pack de froid • Semelle amortissante en gel • Vérification du chaussage				• Pack de froid • Crème arnica • Crème anti-inflammatoire • Canne de marche		• Pack de froid • Crème hydratante pour la cicatrice • Chaussettes de classe 2 en prévention • Canne de marche		• Pack de froid • Crème hydratante pour la cicatrice • Chaussettes de classe 2 en prévention • Cannes

GENOUILLÈRES

GL 120 STANDARD

La genouillère stabilisatrice de 0 à 120°



2 SANGLES VELCRO
pour un meilleur maintien

DÉGAGEMENT IMPORTANT DU CREUX POPLITÉ




ANNEAU ROTULIEN
en forme de strapping (en X)
pour augmenter le recentrage
de la rotule durant l'activité



MAILLE 3D





ARTICULATION POLYCENTRIQUE
en aluminium renforcée,
amovible et capitonnée

- Articulation polycentrique engrénée en aluminium renforcé, amovible et capitonnée, pour favoriser la stabilité du genou au cours du mouvement
- Anneau patellaire en forme de strapping (en X) pour augmenter le recentrage actif de la patella durant l'activité

INDICATIONS :

- Instabilité modérée à chronique du genou
- Entorse des ligaments latéraux
- Séquelles traumatiques
- Protection post-opératoire
- Reprise des activités sportives
- Syndrome rotulien

Disponible en 2 versions : standard ou open pour une mise en place aisée.

Vidéo de mise en place



disponible sur la chaîne Youtube Cizeta Medicali



Polyamide	Aluminium	Elasthanne	Polyoxyméthylène	Polyuréthane	Polyester	Silicone
44.7%	42.2%	7.4%	2.4%	1.7%	0.9%	0.6%

Entretien : lavage à la main à 40°

GL 120 STANDARD						LPPR : 102,29€TTC / 7110588
Taille	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Tour de cuisse	33-38 cm	38-45 cm	45-52 cm	52-57 cm	57-63 cm	63-70 cm
Tour de genou	30-32 cm	33-35 cm	36-38 cm	39-41 cm	42-44 cm	45-48 cm
Standard : par enfilage	3701126320504	3701126320511	3701126320528	3701126320535	3701126320542	3701126303811

Mesure de référence

GENOUILLÈRES

GL 120 OPEN

La genouillère stabilisatrice de 0 à 120° facile à mettre en place



- Articulation polycentrique engrénée en aluminium renforcé, amovible et capitonnée, pour favoriser la stabilité du genou au cours du mouvement
- Anneau patellaire en forme de strapping (en X) pour augmenter le recentrage actif de la patella durant l'activité

INDICATIONS :

- Instabilité modérée à chronique du genou
- Entorse des ligaments latéraux
- Séquelles traumatiques
- Protection post-opératoire
- Reprise des activités sportives
- Syndrome rotulien

Disponible en 2 versions : standard ou open pour une mise en place aisée.

Vidéo de mise en place



disponible sur la chaîne Youtube Cizeta Medicali



Polyamide 44.7% | Aluminium 42.2% | Elasthanne 7.4% | Polyoxyméthylène 2.4% | Polyuréthane 1.7% | Polyester 0.9% | Silicone 0.6%

Entretien : lavage à la main à 40°

GL 120 OPEN						LPPR : 102,29€TTC / 7110588
Taille	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Tour de cuisse	33-38 cm	38-45 cm	45-52 cm	52-57 cm	57-63 cm	63-70 cm
Tour de genou	30-32 cm	33-35 cm	36-38 cm	39-41 cm	42-44 cm	45-48 cm
Open : sans enfilage, fermeture par velcro	3701126320559	3701126320566	3701126320573	3701126320580	3701126320597	3701126303828

Mesure de référence

GENOUILLÈRES

GAMME COMPLETE DE GENOUILLERES ELASTIQUES

Une gamme claire et précise pour couvrir les besoins de chaque patient

Tricotage anatomique et liberté de mouvements



GENOUILLÈRE

FORCE 1

GL STAB

Maintien léger



Bande horizontale à l'intérieur de **SILICONE POUR ÉVITER LE GLISSEMENT**



- Zone de tricotage spécifique au niveau du creux poplité et de la patella pour éviter les conflits de surpression et de striction lors des mouvements

INDICATIONS :

- Chondrite
- Laxité ligamentaire légère
- Œdème traumatique résiduel

Polyamide	Elastodiène	Elasthanne	Silicone	Polyester	Polyuréthane
78%	17%	3%	1%	0,5%	0,5%



Mesure de référence


GL STAB							LPPR : 19,30€TTC / 201D02.5 + 201D04.2
Taille	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Tour de cuisse	38-40 cm	41-43 cm	44-47 cm	48-52 cm	53-57 cm	58-62 cm	63-67 cm
Tour de genou	30-32 cm	33-35 cm	36-38 cm	39-41 cm	42-44 cm	45 -49 cm	50-54 cm
Référence	3701126326650	3701126326667	3701126326674	3701126326681	3701126326698	3701126302777	3701126302784

GENOUILLÈRE

FORCE 2

PATELLA STAB

Maintien renforcé pour instabilité modérée

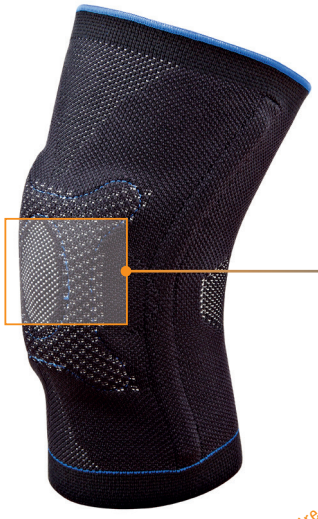

ANNEAU PATELLAIRE SPÉCIFIQUE EN X
pour un recentrage actif de la patella



- Augmentation de la proprioception par stimulation des muscles du quadriceps
- Bandes de silicone pour éviter le glissement
- Anneau confortable permettant une adaptation à la morphologie de la patella

INDICATIONS :

- Syndrome rotulien (Osgood Schlatter, chondrite rotulienne, arthrose fémoro-patellaire, ...)
- Instabilité ligamentaire (séquelles traumatiques)
- Reprise des activités sportives



Polyamide 70% | Elastodiène 15% | Polyuréthane 7% | Polyester 3% | Elasthanne 3% | Silicone 2%



Mesure de référence

PATELLA STAB					LPPR : 24,46€TTC / 201D02.5 + 201D04.4 + 201D04.3 + 201D04.2		
Taille	1	2	3	4	5	6	7
Tour de cuisse	38-40 cm	41-43 cm	44-47 cm	48-52 cm	53-57 cm	58-62 cm	63-67 cm
Tour de genou	30-32 cm	33-35 cm	36-38 cm	39-41 cm	42-44 cm	45 -49 cm	50-54 cm
Référence	3701126326759	3701126326766	3701126326773	3701126326780	3701126326797	3701126302814	3701126302821

GENOUILLÈRE

FORCE 3

GL STRAPP

Maintien intense pour reprise sportive et entorse bénigne



Bande de strapp permettant d'amplifier le **MAINTIEN LATÉRAL ET PATELLAIRE**
lors des activités



ANNEAU PATELLAIRE SPÉCIFIQUE EN X

- Augmentation accrue de la proprioception grâce à l'action combinée des bandes de strapp et de l'anneau patellaire
- Bandes de silicone pour éviter le glissement
- Mise en place intuitive

INDICATIONS :

- Laxité ligamentaire chronique modérée
- Séquelle traumatique
- Syndrome rotulien modéré
- Reprise des activités sportives
- Entorse bénigne



Polyamide 55% | Polyester 21% | Elastodiène 17% | Polyuréthane 5% | Elasthanne 1,5% | Silicone 0,5%




Mesure de référence

GL STRAPP					LPPR : 24,46€TTC / 201D02.5 + 201D04.4 + 201D04.3 + 201D04.2		
Taille	1	2	3	4	5	6	7
Tour de cuisse	38-40 cm	41-43 cm	44-47 cm	48-52 cm	53-57 cm	58-62 cm	63-67 cm
Tour de genou	30-32 cm	33-35 cm	36-38 cm	39-41 cm	42-44 cm	45 -49 cm	50-54 cm
Référence	3701126326704	3701126326711	3701126326728	3701126326735	3701126326742	3701126302791	3701126302807

ATTELLES DE GENOU

CIROM

Attelle de genou articulée réglable en amplitude

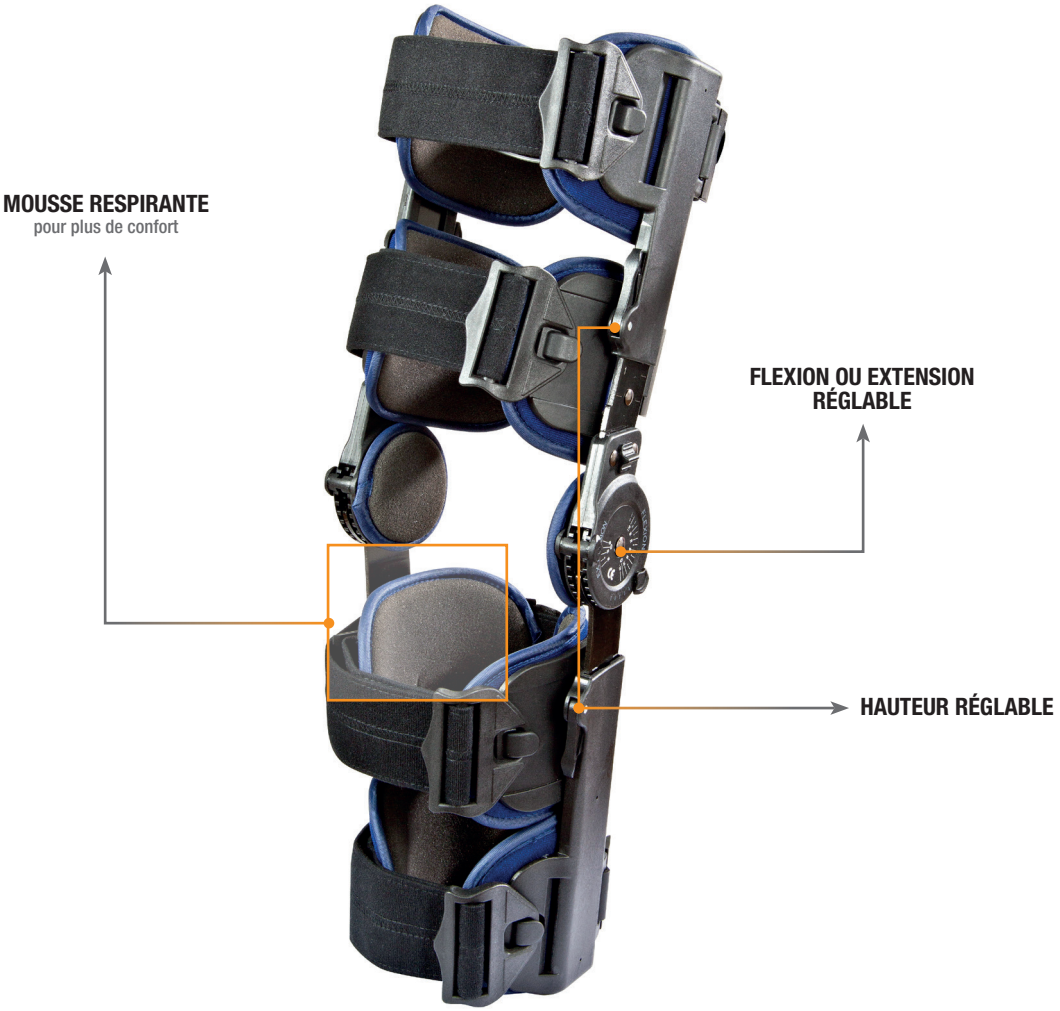

Indiqué dans le cadre d'une immobilisation suite à une intervention chirurgicale

- Taille unique adaptable à la morphologie du patient
- Articulations en aluminium rigide, offrant une protection et un contrôle de l'amplitude de mouvement tous les 10°
- Blocage rapide en extension de -10° à 30°
- Flexion réglable en amplitude de -10° à 120°
- Réglage télescopique simple de 48 cm à 69 cm pour s'adapter à la plupart des patients

INDICATIONS :

- Entorse du LCP, LCA, LLI, LLE
- Post-opératoire suite à une ligamentoplastie du genou
- Post-réparation du ménisque
- Chirurgie du genou
- Phase de rééducation

Vidéo de mise en place



disponible sur la chaîne Youtube Cizeta Medicali

CIROM	LPPR : 102,29€TTC / 7110588
Taille	**Unique**
Longueur	48-69 cm
Circonférence mollet	25-50 cm
Circonférence cuisse	30-70 cm
Référence	3701126307949


Polyamide (plastique) 40% | Aluminium 40% | Mousse polyuréthane 10%
Polyamide (tissu) 5% | Polyamide (velcro) 5%

ATTELLES DE GENOU

PERFO UNI 3

Attelle d'immobilisation à 0° ou 20°



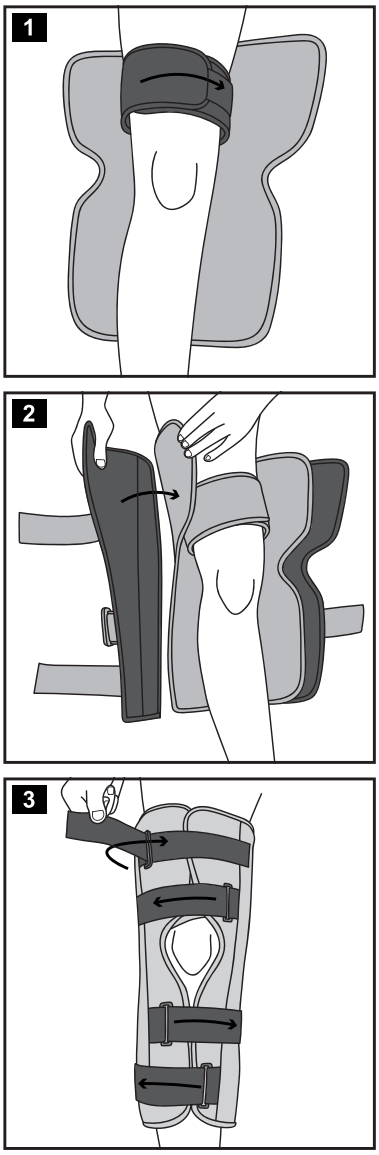



PRISE DE MESURE :

- Longueur de la jambe : distance entre la cheville (à 3 cm de la malléole) et l'entrejambe (à 3 cm)

- Adaptation à la morphologie de la jambe grâce aux trois volets
- Mousse macro-perforée pour un confort accru
- Facilité d'application et de réglage grâce à la sangle fémorale interne

INDICATIONS :

- Traumatisme du genou
- Entorse
- Séquelle de fractures
- Maintien post-opératoire
- Mise au repos (arthrite, polyarthrite)
- Urgence et diagnostic différé

Polyuréthane	Coton	Polyamide
48%	30%	22%

PERFO UNI 3			LPPR : 57,23€TTC / 7110393
Taille	**1**	**2**	**3**
Longueur	40 cm	50 cm	60 cm
Référence	3701126312974	3701126312981	3701126312998


PERFO UNI 3 - 20°			LPPR : 57,23€TTC / 7110393
Taille	**1**	**2**	**3**
Longueur	40 cm	50 cm	60 cm
Référence	3701126314527	3701126314534	3701126314541


Babolat
A2T



CHEVILLE

COMMENT BIEN DÉLIVRER UNE CHEVILLÈRE, UNE ATTELLE OU UNE BOTTE ?

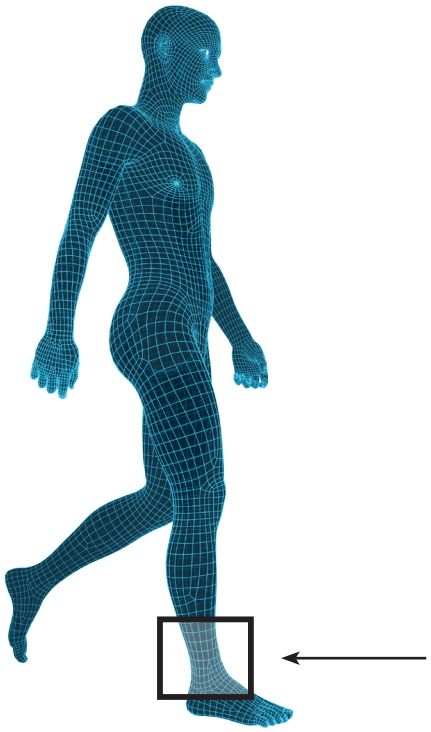



PRISE DE MESURE :

- Mesurer la circonférence de la cheville 2 cm au dessus de la malléole.
- Si la cheville est œdématiée, mesurer l'autre cheville.

ATTELLES DE CHEVILLE

A2T® 60
CISTAB 62

CHEVILLÈRES

TALO STAB 64
TALO PROTECT 65
TALO STRAPP 65

BOTTES

CIZETA BOOTS 66
CIZETA BOOTS AIR 67

ARBRE DÉCISIONNEL

Besoin de maintien | **Reprise sportive et phase de rééducation** | **Immobilisation et Post-Op**

Maintien léger	Maintien renforcé	Maintien intense	Entorse moyenne à grave		Entorse grave Fracture	
TALO STAB	TALO PROTECT	TALO STRAPP	CISTAB	A2T®	CIZETA BOOTS	CIZETA BOOTS AIR
						
p.64	p.65	p.65	p.62	p.60	p.66	p.67

LES TRAUMATISMES DE LA CHEVILLE



CIZETA ortò

Questionnaire : évaluer le niveau d'instabilité de la cheville

Cette évaluation ne permet pas de faire un diagnostic médical. Si le patient n'arrive pas à marcher et que le traumatisme est récent, il est conseillé de consulter un médecin.

Douleur :
- ☐ Traumatisme récent de la cheville (entorse, choc, chute), pas d'œdème et pas d'ecchymose : **5 points**
- ☐ Localisation périmalléolaire (malléole interne ou externe) : **3 points**
- ☐ Pendant les activités sportives : **4 points**
- ☐ Localisée en niveau du cou-de-pied : **2 points**
- ☐ Pas de douleur : **0 point**

Œdème :
- ☐ En permanence : **5 points**
- ☐ Après activité : **3 points**
- ☐ Pas d'œdème : **0 point**

Sensation d'instabilité :
- ☐ Permanente : **5 points**
- ☐ Uniquement durant le sport : **3 points**
- ☐ Léger : **1 point**
- ☐ Aucune instabilité : **0 point**

Conflit articulaire : sensation de ressaut (claquement interne) :
- ☐ Au niveau des malléoles : **3 points**
- ☐ À l'intérieur de la cheville : **5 points**
- ☐ Au niveau du cou-de-pied : **3 points**
- ☐ Non : **0 point**

TOTAL : / 20

Instabilité

0 — 6 — 12 — 18 — >18 consultation médicale recommandée et port d'une attelle de maintien rigide A2T

TALO STAB — TALO PROTECT — TALO STRAPP

Les orthèses Cizeta ortò sont des dispositifs médicaux, indiqués dans le traitement des troubles musculo-squelettique et élaborés par Cizeta Medicali. Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et suivre les recommandations pour un bon usage. En cas de besoin, demandez conseil à un professionnel de santé. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE (directive 93/42/CEE). Février 2017 - 1735059PRO

Pensez à commander :
Le bloc **Questionnaire Instabilité de la Cheville** pour une **meilleure délivrance**


	1	2	3	4
Pathologie	**Instabilité de la cheville**	**Entorse bénigne**	**Entorse bénigne à moyenne**	**Entorse moyenne à grave de la cheville** associée ou non à un Chopart
Solution ortò CIZETA	 **Chevillère Gamme Talo** *(utiliser le questionnaire pour choisir le modèle adapté)*	 **Chevillère Talostrapp**	 **Cistab**  **Pack de froid**	 **A2T**  **Pack de froid** + Paire de **cannes** confort (temporaire)
Protocole de port et conseils associes	Durant les activités à risque	10 jours	4 semaines + protocole GREC	• A2T : 6 semaines • Protocole GREC • Maintenir la compression pendant 4 mois
Reprise marche	Immédiate	Reprise de la marche le plus tôt possible (idéalement 2 jours après le traumatisme), avec orthèse dans la chaussure.		
Reprise d'activité sportive	Possible avec chevillère	Progressive après 10 jours	Progressive après 4 semaines	Progressive après 8 à 12 semaines

LES TRAUMATISMES DE LA CHEVILLE

90%

des entorses de cheville : mouvement d'inversion*

* Sophia Chui-Wai Ha a, Daniel Tik-Pui Fong b, , Kai-Ming Chan, Review of ankle inversion sprain simulators in the biomechanics laboratory, Asia-Pacific Journal of Sports Medicine, Arthroscopy, Rehabilitation and Technology (2015)

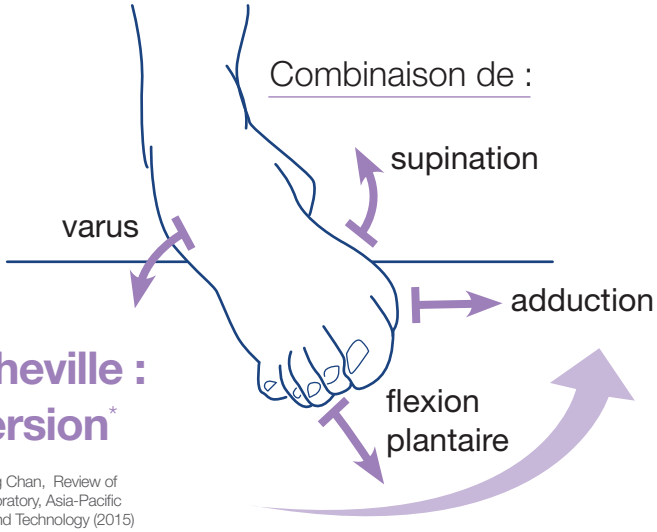

45%

des cas : les atteintes du médio-pied (Chopart) associés ne sont pas décelés à J. O*

*Roemer F Ligamentous Injuries and the Risk of Associated Tissue Damagein Acute Ankle Sprains in Athletes: The American Journal of Sports Medicine, Vol. 42, No. 7

Le protocole GREC



Glaçage 20 minutes 4 fois par jour

Repos de 3 jours sans appui forcé sur la cheville

Élévation de la cheville au maximum (surélever en position assise, surélever dans le lit)

Compression avec un bandage ou mi-bas de compression pour réduire l'œdème

DEMA PHASE 2 PHASE 3

5	6	7
Relais immobilisation rigide (plâtre, résine) après fracture de la cheville ou médio-pied, entorse grave avec arrachement osseux	**Immobilisation rigide** (plâtre, résine) après fracture de la cheville ou médio-pied, entorse grave avec arrachement osseux	**Fracture cheville, fracture médio-pied, entorse grave avec arrachement osseux, Lisfranc**
  **A2T** **Pack de froid** + Paire de **cannes** confort (temporaire)	  **Chaussure plâtre Cizeta** **Paire de cannes confort**	   **Cizeta Boots Air** **Cizeta Boots** **Paire de cannes confort**
• 4 semaines en moyenne • Protocole GREC • Maintenir la compression pendant 4 mois	• Protection de l'immobilisation rigide • Après retrait de l'immobilisation, ne pas oublier la phase d'instabilité (voir n°1)	• 6 à 12 semaines nuits et jours • Après retrait si instabilité, relais avec la gamme élastique
Immédiate	• Pas d'appui possible durant la première phase (suivre recommandations du médecin)	• Pas d'appuis durant la première phase
Progressive après 8 semaines	Après 12 semaines. Suivre les recommandations du médecin.	

ATTELLES DE CHEVILLE

A2T®

Modèle bilatéral

MODÈLE BREVETÉ

Le nouveau concept d'attelle de cheville

A2T®

SON MAINTIEN OPTIMAL PERMET UNE IMMOBILISATION AVEC OU SANS CHAUSSURE.

Légère, adaptable et peu encombrante, l'A2T® pourra se glisser facilement dans la chaussure.

- Polymère thermoplastique permettant une adaptation à la morphologie du mollet et du pied
- Mousse fine respirante et confortable pour une protection du pied

Vidéo de mise en place



disponible sur la chaîne Youtube Cizeta Medicali

INDICATIONS :

- Entorse moyenne à grave de la cheville
- Post-op après ligamentoplastie



Empêche les mouvements
DE VARUS ET VALGUS

DORSIFLEXION LIBRE
pour une rééducation
après traumatisme.

MALLÉOLE DÉGAGÉE
pour le glaçage

Limite la
FLEXION PLANTAIRE

Coque :
Polyamide 100%

Protection :
Polyuréthane 50% | Polyester 30% | Coton 20%

Pointure de chaussure

A2T®			LPPR : 27,44€TTC / 7110401
Taille	**1**	**2**	**3**
Pointure	34-39	39-44	44-48
Référence	3701126307307	3701126307314	3701126300643

L'A2T® (Attelle Talo-Tarsienne) **est le nouveau concept d'orthèse stabilisatrice après entorse moyenne à grave de la cheville.**

ACTUALITÉ

L'étude clinique menée par Cizeta Medicali confirme les 30% de récidive après entorse de cheville.

L'étude a comparé le délai de reprise de la marche sans douleur après entorse de la cheville de grade I et II du ligament collatéral latéral (lésion fonctionnelle du faisceau antérieur LTFA et lésion possible du LCF) avec une orthèse stabilisatrice de cheville (A2T®) versus une orthèse à double coque*.

95% des patients recommandent l'A2T® suite à son utilisation
(confort et efficacité)

*Essai contrôlé, randomisé, conduit en ouvert de mai 2015 à juin 2016 ; réception des données le 04/07/2016. Data-Manager : CENBIOTECH DIJON



MAINTIEN OPTIMAL avec ou sans chaussure

CHIFFRES CLÉS

- **6 000 entorses** de cheville / jour
- **30%** de récidive
- **20% à 30% des traumatismes sportifs** avec une durée d'arrêt de travail de 3 semaines
- **1,2 million €** en coût journalier de frais médicaux
- **5 à 20% d'instabilité chronique***

*Sources : Conférence de consensus « l'entorse de la cheville au service d'urgence », actualisation de 2004 ; ANAES, Rééducation de l'entorse externe de la cheville, janvier 2000.



Malléole dégagée **POUR LE GLAÇAGE**

PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L'ÉTUDE CLINIQUE :

- 2 jours

REPRISE DE LA MARCHE
Amélioration du délai de reprise de la marche :
- 2.2 jours avec l'A2T
- 4.2 jours avec une double coque

+37%

AMÉLIORATION DE L'ÉVOLUTION DE L'ENTORSE
+37% d'amélioration selon les cliniciens : diminution de l'oedème, des ecchymoses et de la douleur.
- 93% des entorses s'améliorent avec l'A2T
- 68% avec une double coque, soit 1 entorse sur 3 qui n'évolue pas correctement.

+36%

OBSERVANCE
Amélioration de l'observance de plus de 36% avec l'A2T.



STABILISE en bloquant le calcanéum

ATTELLES DE CHEVILLE

CISTAB

Modèle bilatéral

L'attelle de cheville double coque



COQUES DE FORME ANATOMIQUE

SANGLE RÉGLABLE
pour adapter l'orthèse à la largeur du pied



MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME
macro-perforée

- Mousse à mémoire de forme macro-perforée

INDICATIONS :

- Entorse de gravité moyenne à grave de la cheville
- Relais post-ablation plâtre

Coque :
Polypropylène 100%

Protection :
Polyuréthane 48% | Coton 30% | Polyamide 22%

CISTAB	LPPR : 27,44€TTC / 7110401
Taille	Unique
Référence	3701126307956

LA BONNE ATTELLE

selon le niveau de gravité de l'entorse

Classification internationale simplifiée de TREVINO

Classification	Grade I (entorse bénigne)	Grade II (entorse moyenne)	Grade III (entorse sérieuse)	Grade IV (entorse grave)	Instabilité chronique	Post-op	Atteinte du médio-pied
Pathologie	• Etirement LTFA	• Rupture partielle du LTFA	• Rupture complète LTFA + LCF • Rupture interstitielle des tendons fibulaires • Subluxation ou luxation des tendons fibulaires	• Rupture complète LTFA + LCF • Arrachement de la pointe malléolaire • Fracture du dôme talien • Fracture de la joue latérale	• Post-traumatique • Arthrose • Syndrome d'Ehlers-Danlos	• Ligamento-plastie de la cheville et du médio-pied	• Atteinte du Chopart, et/ou du Lisfranc
Indications de l'A2T	*****	*****	**** associé ou non en relais post-immobilisation	*** en relais post-immobilisation	****	*****	*****
Indication de la Cistab (double coque)	*****	*	*non indiqué*	*non indiqué*	**	**** (LCF) *non indiqué pour le médio-pied*	*non indiqué*

LTFA : ligament talofibulaire antérieur
LCF : ligament calcanéofibulaire

CISTAB
(double coque)



A2T®
Amélioration de l'évolution de l'entorse prouvée par une étude clinique



CHEVILLÈRES

GAMME COMPLÈTE DE CHEVILLÈRES ELASTIQUES

Une gamme claire et précise pour couvrir les besoins de chaque patient

Tricotage anatomique et liberté de mouvements



Choisir la bonne chevillère





CHEVILLÈRES

FORCE 1

TALO STAB

Maintien léger



Zone de tricotage spécifique au niveau du talon et du cou-de-pied pour éviter les conflits de surpression et de striction lors des mouvements

INDICATIONS :

- Laxité ligamentaire légère
- OEdème traumatique résiduel



Polyamide	Elastodiène	Elasthanne	Polyester	Polyurethane
79%	17%	3%	0,5%	0,5%



TALO STAB					LPPR : 16,19€TTC / 201D02.6
Taille	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Tour de cheville	19-20 cm	21-22 cm	23-24 cm	25-26 cm	27-28 cm
Référence	3701126326506	3701126326513	3701126326520	3701126326537	3701126326544

CHEVILLÈRES

FORCE 2

TALO PROTECT

Maintien renforcé





- Augmentation de la proprioception au niveau de la cheville
- Adaptation à la morphologie des malléoles
- Coussinets péri-malléolaires pour une action concentrée sur la cheville lors des activités sportives

INDICATIONS :

- Laxité ligamentaire chronique
- Séquelles traumatiques
- Prévention active lors des activités sportives

Polyamide	Elastodiène	Polyuréthane	Elasthanne	Polyester
71%	15%	7%	4%	3%



TALO PROTECT					LPPR : 18,77€TTC / 201D02.6 + 201D04.4
Taille	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Tour de cheville	19-20 cm	21-22 cm	23-24 cm	25-26 cm	27-28 cm
Référence	3701126326605	3701126326612	3701126326629	3701126326636	3701126326643

CHEVILLÈRES

FORCE 3

TALO STRAPP

Maintien intense







- Bande de strapp permettant de limiter le mouvement de varus-supination
- Augmentation de la proprioception au niveau de la cheville et du médio-pied
- Facilité d'usage et de réglage grâce aux pictogrammes

INDICATIONS :

- Laxité ligamentaire chronique modérée
- Entorse bénigne
- Relais après immobilisation prolongée
- Phase de réadaptation sportive

Polyamide	Polyester	Elastodiène	Polyuréthane	Elasthanne	Polyéthylène
41%	31%	22%	4%	1,9%	0,1%




TALO STRAPP					LPPR : 18,77€TTC / 201D02.6 + 201D04.4
Taille	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Tour de cheville	19-20 cm	21-22 cm	23-24 cm	25-26 cm	27-28 cm
Référence	3701126326551	3701126326568	3701126326575	3701126326582	3701126326599

BOTTES D'IMMOBILISATION

CIZETA BOOTS

Modèle bilatéral

Pour les traumatismes de la cheville et du pied

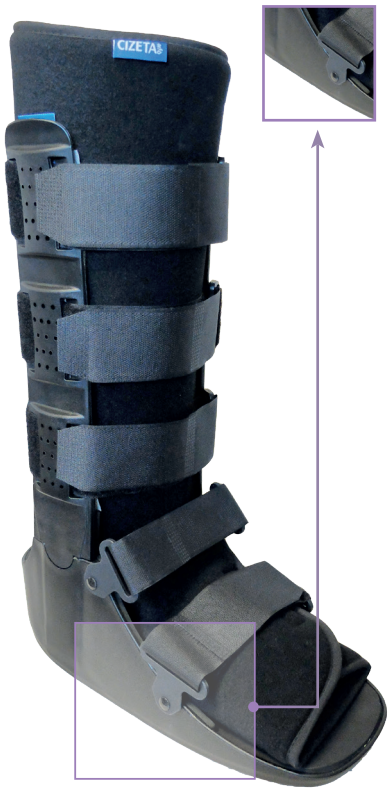

SEMELLE LARGE À ABSORPTION DE CHOC
pour une bonne stabilité et un confort optimal



BOOTS LONGUE

BOOTS COURTE

- Léger :
  Boots courte (de 0.9 Kg à 1,2 Kg selon la taille)
  Boots longue (de 1 Kg à 1,3 Kg selon la taille)
- Facile à mettre en place

INDICATIONS :

- Fracture du tiers inférieur de la jambe
- Fracture du pied et/ou de la cheville
- Entorse grave de la cheville
- Rupture du tendon d'Achille

Coque :

Polypropylène 85%	Fibre de verre 15%

Protection :

Polypropylène 30%	Polyester 18%	TPR 15%
EVA 14%	Polyamide 12%	Carton 10%
Métal 1%		

CIZETA BOOTS				LPPR : 64,40€TTC / 7110418
Taille	**1**	**2**	**3**	**4**
Pointure	36-38,5	38-43	43-46,5	≥ 46,5
Longue	3701126307673	3701126307666	3701126307659	3701126307680
Courte	3701126307611	3701126307628	3701126307635	3701126307642

BOTTES D'IMMOBILISATION

CIZETA BOOTS AIR

Modèle bilatéral

L'immobilisation qui s'adapte à chaque morphologie

SEMELLE LARGE
à absorption de choc
et antidérapante pour une
bonne stabilité




LÉGER
de 0.9 Kg à 1,2 Kg
selon la taille

BOOTS COURTE

VALVES POUR GONFLAGE
indépendantes

DOUBLE COQUE
antérieure et postérieure
pour une meilleure
immobilisation

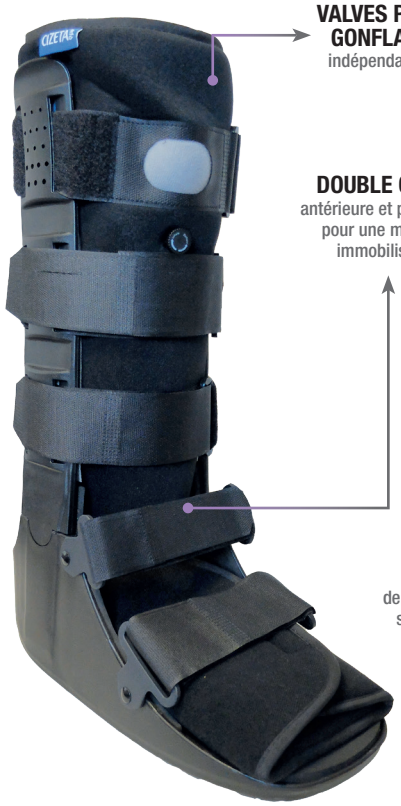

LÉGER
de 1 Kg à 1,3 Kg
selon la taille

BOOTS LONGUE

Botte de marche à double cellule pneumatique associée au tissu COOLMAX®, offrant la meilleure combinaison entre immobilisation, compression et confort.

COOLMAX® : est un tissu haute technologie unique, créé à partir d'une fibre polyester Dacron.

- L'habillage composé de 2 cellules d'air apporte maintien, confort et protection
- Livrée avec une pompe pour le réglage de la pression d'air
- Semelle interne amovible
- Léger et facile à mettre en place

INDICATIONS :

- Fracture du tiers inférieur de la jambe
- Fracture du pied et/ou de la cheville
- Entorse grave de la cheville
- Rupture du tendon d'Achille

Vidéo de mise en place



disponible sur la chaîne Youtube
Cizeta Medicali



Coque :

Polypropylène 85%	Fibre de verre 15%


Protection :

Polypropylène 26%	Polyester 15%	TPR 12%	EVA 12%	Polyamide 10%	TPU 9%	Carton 9%	PVC 6%	Métal 1%

CIZETA BOOTS AIR				LPPR : 64,40€TTC / 7110418
Taille	**1**	**2**	**3**	**4**
Pointure	36-38,5	38-43	43-46,5	≥ 46,5
Longue	3701126315432	3701126317344	3701126317351	3701126317368
Courte	3701126313995	3701126314497	3701126315418	3701126315425



PIED

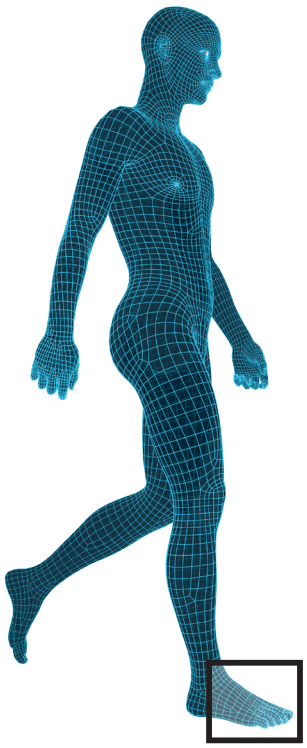

COMMENT BIEN DÉLIVRER UNE CHAUSSURE C.H.U.T. UN RELEVEUR DE PIED ?



PRISE DE MESURE :
- Pointure

CHAUSSURE
C.H.U.T. CLASSIQUE 70
C.H.U.T. DÉCHARGE ARRIÈRE 70
C.H.U.T. DÉCHARGE AVANT 71

RELAIS PLÂTRE
CHAUSSURE PLÂTRE 71

RELEVEUR
RELEVEUR STATIQUE 72
RELEVEUR DYNAMIQUE : RELEVEUR A2T® 72

A R B R E D É C I S I O N N E L

Chaussure

C.H.U.T CLASSIQUE



p.70

C.H.U.T DÉCHARGE ARRIÈRE



p.70

C.H.U.T DÉCHARGE AVANT



p.71

Relais plâtre

CHAUSSURE PLÂTRE



p.71

Releveur statique

RELEVEUR DE PIED



p.72

Releveur dynamique

RELEVEUR A2T®




p.72

CHAUSSURE

C.H.U.T CLASSIQUE

Modèle bilatéral

La Chaussure Thérapeutique à Usage Temporaire

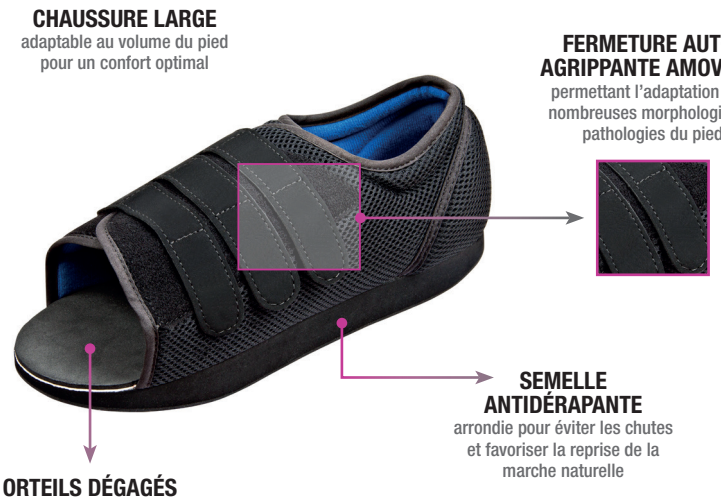

- Forme ergonomique de la semelle pour un maintien optimum du talon
- Cicatrisation facilitée grâce aux matières respirantes
- Ouverture totale de la chaussure pour un enfilage facilité

INDICATIONS :

- Œdème
- Lymphœdème
- Post-opératoire avec bandage important
- Port de prothèse
- Déformation importante du pied



Polyester	Polyuréthane	Polyamide
50%	30%	20%

C.H.U.T CLASSIQUE					LPPR : 27,51€TTC / 7110447
Taille	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
Pointure	33-35	35-38	38-40	40-43	43-45
Référence	3701126302104	3701126302111	3701126302128	3701126302142	3701126302135

CHAUSSURE

C.H.U.T DÉCHARGE ARRIÈRE

Modèle bilatéral

Pour les atteintes de l'arrière-pied



- Décharge complète de l'arrière-pied
- Semelle étudiée pour faciliter la marche
- Chaussure large, adaptable au volume du pied pour un confort optimum.

INDICATIONS :

- Chirurgie de l'arrière-pied
- Traumatologie de l'arrière-pied (fracture du calcanéum)
- Ulcère plantaire de l'arrière-pied
- Ulcération de l'arrière-pied



TPE	Polyamide	Polyuréthane	EVA	Polyester	Coton
50%	20%	10%	10%	5%	5%

C.H.U.T DÉCHARGE ARRIÈRE					LPPR : 30,49€TTC / 7110430
Taille	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
Pointure	33-36	36-39	39-41	41-44	44-47
Référence	3701126302197	3701126302203	3701126302210	3701126302227	3701126302234

CHAUSSURE

C.H.U.T DÉCHARGE AVANT

Modèle bilatéral

Pour les atteintes de l'avant-pied



TPE	Polyamide	Polyuréthane	EVA	Polyester	Coton
50%	20%	10%	10%	5%	5%

- Facilite la marche
- Chaussure large, adaptable au volume du pied pour un confort optimum
- Fermeture auto-agrippante amovible au niveau du pied, permettant l'adaptation à de nombreuses morphologies et pathologies du pied

INDICATIONS :

- Chirurgie de l'Hallux-Valgus
- Traumatologie de l'avant-pied (fractures des métatarsiens)
- Maux perforants plantaires
- Ulcération de l'avant-pied
- Brûlures
- Amputation
- Syndrome douloureux régional complexe (syndrome algo-neuro-dystrophique)

C.H.U.T DÉCHARGE AVANT					LPPR : 30,49€TTC / 7110424
Taille	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
Pointure	33-36	36-39	39-41	41-44	44-47
Référence	3701126302241	3701126302258	3701126302265	3701126302272	3701126302289

PIED

CHAUSSURE PLÂTRE

Modèle bilatéral

Pour protéger le plâtre lors des déplacements



- Semelle antidérapante
- Protection des plâtres lors des déplacements : hygiène
- Fermeture par sangles auto-agrippantes

INDICATIONS :

- Post-opératoire sous plâtre
- Protection des plâtres lors des déplacements

Polyester	Polyuréthane	Polyamide	Caoutchouc
40%	30%	20%	10%

CHAUSSURE PLÂTRE				Non remboursé par la Sécurité Sociale
Taille	**1**	**2**	**3**	**4**
Pointure	33-35	35-40	40-44	44-46
Référence	3701126302159	3701126302166	3701126302173	3701126302180

PIED

RELEVEUR DE PIED

Maintien du pied à angle droit







Polypropylène 75%	Polyester 9,5%	Polyuréthane 9,5%
Polyamide 5%	Fer 1%	

- Prévient tout déséquilibre latéral
- Réajustable à la longueur du pied par découpe
- Modification possible au pistolet thermique
- Léger et discret

INDICATIONS :

- Atteintes des releveurs du pied
- Hémiplégie avec séquelle de paralysie flasque
- Lésions du nerf sciatique poplité externe

RELEVEUR DE PIED				LPPR : 76,22€TTC / 7110453
Taille	**1**	**2**	**3**	**4**
Pointure	35-37	37-39	39-41	41-44
Référence Pied Droit	3701126302296	3701126302302	3701126302319	3701126302326
Référence Pied Gauche	3701126302333	3701126302340	3701126302357	3701126302364

PIED

RELEVEUR A2T

Releveur de pied dynamique





Coque :

Polyamide 100%

Sangle élastique :

Polyester 69,90%	Elastodiène 30,10%

Protection :

Polyuréthane 50%	Polyester 30%	Coton 20%

Vidéo de mise en place

disponible sur la chaîne Youtube Cizeta Medicali

- Prévient tout déséquilibre latéral
- Améliore la capacité de marche du patient, en limitant les mouvements en varus/valgus
- Maintien de la cheville à angle droit
- Peut être porté avec tous types de chaussures
- Mise en place avec ou sans chaussures
- Modèle bilatéral

INDICATIONS :

- Atteintes des releveurs du pied
- Hémiplégie avec séquelle de paralysie flasque
- Lésion du nerf sciatique poplité externe
- Paralysies traumatiques
- Paralysies neurologiques

RELEVEUR A2T®			LPPR : 76,22€TTC / 7110453
Taille	**1**	**2**	**3**
Pointure	34 - 39	39 - 44	44 - 48
Référence	3701126306249	3701126306256	3701126306263

CANNES & ACCESSOIRES

CANNES

CANNE CLASSIQUE 74

ACCESSOIRES

PACKS CHAUD / FROID 74
BANDAGE HERNIAIRE 75
COUSSIN BINET 75



AIDES DE MARCHE & DÉAMBULATION

CANNE CLASSIQUE



Vendu par paire

Retrouvez nos cannes classique, confort et enfant dans notre catalogue Cizeta Care



- Poignée : Polypropylène
- Tube : Duraluminium

ACCESSOIRES

PACKS CHAUD / FROID



Référence	3701126304931

- **Thermothérapie :** utilisation de la chaleur favorisant la vasodilatation pour apaiser les tensions musculaires, prévenir et soulager la douleur
- **Cryothérapie :** utilisation du froid dans les cas de déchirures musculaires, contusions et blessures, le froid favorisant la réduction de l'œdème par vasoconstriction

CHAUFFAGE AU MICRO-ONDES :

Placer le pack gel à plat au micro-ondes, chauffer 25 secondes maximum à 1050 W maximum. Sortir le pack gel du micro-ondes et le malaxer avec les mains pour que la température se répartisse de façon homogène.
Si la chaleur souhaitée n'est pas atteinte, vous pouvez répéter l'opération 15 secondes, plusieurs fois si nécessaire.

ATTENTION

Ne jamais dépasser le temps de chauffe maximum par répétition. Si le pack gel commence à gonfler, arrêter le micro-ondes et laisser refroidir avant de les retirer.

ACCESSOIRES

BANDAGE HERNIAIRE



- Tissu Microfibres
- Sous-cuisses réglables
- Échancrure anatomique
- 2 pelotes intégrées

INDICATIONS :

- Hernies inguinales légères à moyennes

BANDAGE HERNIAIRE			LPPR : 33,72€TTC / 201A00.23
Taille	**1**	**2**	**3**
Tour de taille	75-90 cm	91-105 cm	106-120 cm
Référence	3701126307543	3701126307550	3701126307567

ACCESSOIRES

COUSSIN BINET


POUR LE PRATICIEN AU CABINET
Position d'attente du blessé du membre inférieur.
Avant ou après déshabillage.





Mousse Polyéthylène réticulée à cellules fermées.

POUR LE PATIENT À DOMICILE
Soutien d'immobilisation du genou
ou plâtre cruro-pédieux.
Le coussin Binet peut être doublé
pour une meilleure répartition.





Référence	3701126307963

- Innovation développée en partenariat avec le Docteur Binet, médecin spécialiste en médecine d'urgence et traumatologie du sport

INDICATIONS :

- Examen clinique facilité, notamment pour le test de Lachman
- Déshabillage plus confortable des blessés, ablation de la chaussure, transport avant et après immobilisation
- Mise au repos du membre inférieur blessé (fracture, entorse)
- Repos pour plâtre cruro-pédieux
- Repos pour genou sous attelle
- Repos pour genou strappé,
- Positionnement de jambe immobilisée : botte plâtrée, immobilisation de cheville
- Positionnement sur le segment inférieur ou supérieur

Outils marketing

Vitrines février - mars - avril

SEMI-TRANSPARENT

Ethéré
- **1 Poster Seta / Ethéré 2020** 59 x 42 cm
- **1 Boîte Varisan vide noire**
- **1 cube**
- **1 jambe + 1 bas démo** Ethéré Poudré (ou Marine, Gris, Nacré, Taupe)



Plumetis
- **1 Poster Plumetis Anaelle** 59 x 42 cm
- 2 Ballons Rose
- 2 Ballons Bleu
- 2 Ballons Argentés
- **1 cube**
- **2 demi-jambe + 2 démo Plumetis** (1x Noir/Rose 1x Marine/Argenté)
- **1 boite Plumetis vide**



Maternité
- **1 Poster Grossesse SL Maternity Dema Varitec 2020** 50 x 70 cm
- **Livrets patiente grossesse** présentés ouverts
- **1 cube**
- **2 jambes + 2 bas démo Ethéré** (au choix : Poudré, Terra, Taupe, Gris, Marine)
- **5 stickers** Papillon Blanc



Vitrines février - mars - avril

SEMI-TRANSPARENT

Plumetis
- **1 PLV Varisan Plumetis Diva** 55 x 150 cm
- 3 Ballons rose métallisé
- **1 cube**
- **1 demi-jambe + 1 démo Plumetis**
- **1 boite Plumetis vide**



TRANSPARENT

DIVA
- **1 Poster DIVA 2020** 118 x 42 cm ou **1 PLV Varisan Plumetis Diva**
- **4 jambes + 4 bas démo**
  - PF : Naturel, Poudré, Terra
  - PO : Nacré
- **5 stickers** Papillon blanc
- **1 boîte vide** DIVA



Vitrines mai - juin - juillet

DIVA
- **2 Posters DIVA 2020** 118 x 42 cm
- **4 jambes + 4 bas démo**
  - PF : Naturel, Poudré, Terra
  - PO : Nacré
- **5 stickers** Papillon blanc
- **1 boîte vide** DIVA



Vitrines septembre - octobre - novembre

NATUREL

Soie Voyage
- **1 PLV Varisan Soie Voyage 2021** 55 x 150 cm
- **1 cube**
- **1 semainier PLV Soie**
- **4 demi-jambes + 4 mi-bas démo** Soie Rouge, Moutarde, Vert et Bleu
- **1 Livret Risques Voyage et Télétravail**



Soie Télétravail
- **1 Poster Soie Télétravail 2021** homme/femme 118 x 42 cm
- **1 cube**
- **1 semainier PLV Soie**
- **4 demi-jambes + 4 mi-bas démo** Soie Rouge, Moutarde, Vert et Bleu
- **1 Livret Risques Voyage et Télétravail**



Seta bas
- **1 Poster SETA** 59 x 42 cm
- **1 cube**
- **2 Boîtes vides Seta**
- **2 jambes + 2 bas démo** Seta Orage et Noir
- **3 demi-jambes + 3 bas démo Seta** (Moutarde, Rouge, Marine)



Outils marketing


PHLÉBOLOGIE



Poster DEMA - **1835227PLV**



Dépliant DEMA 3
1835218CAT

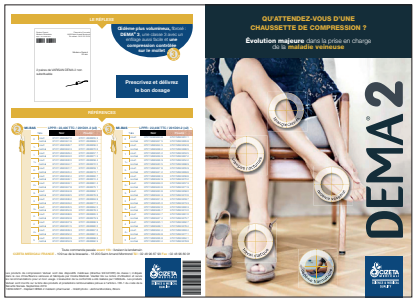

Dépliant DEMA 2 médecin pharmacien
18352429CT



DEMA Ballon jaune
18352345PRO

CAMPAGNE VOYAGE & TÉLÉTRAVAIL



Livret risques télétravail voyage 8 pages
9999920352526




Stop rayon voyage
9999920352519

CAMPAGNE GROSSESSE



Livret patiente grossesse 8 pages
1835198CAT

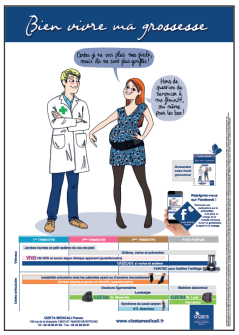


Poster grossesse A3
1835210PLV




Poster grossesse SL Maternity-Dema-Varitec 2020
20352463PLV


DANS MA CABINE...

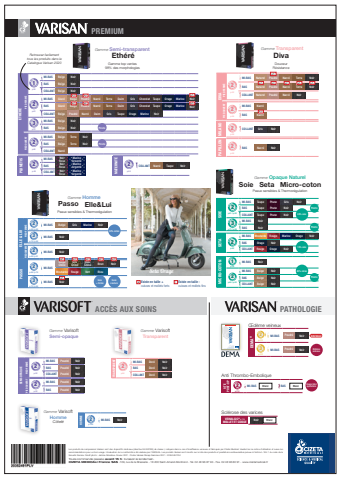

Poster Varisan Récap Gammes 2022

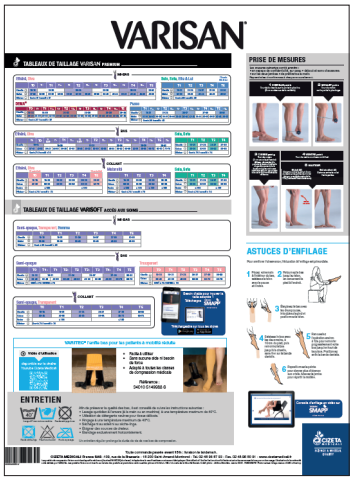

Poster Varisan Mesure Taillage 2022



Bloc prise de mesure
99920352493CT



Poster Enfile-bas Varitec
9999920352523



Porte-nuancier métal + vis
18352425PLV

ORTHOPÉDIE



PLV Orto SL Lady / SL 500
LAMA-154.9



PLV Orto A2T / GL 120
18352385PLV



Poster Lombalgie SL Lady
Anaelle Leclercq
18352418PLV



Poster arbres décisionnels orthopédie




PLV chevalet ATL Seamless
18352388PLV



Dépliant-poster pharmacien rachis
1835199CAT



Dépliant-poster pharmacien genou
20352459CT



Bloc Questionnaire Lombalgie **B4**



Bloc Questionnaire Genou **B3**



Dépliant-poster pharmacien entorse cheville
1835199CAT



Bloc Questionnaire Cheville **B2**



Dépliant-poster pharmacien main-poignet
18352383CT

Outils marketing

Au cœur de Cizeta Medicali... en vidéo

Nos vidéos de mises en place orthopédie

Vidéo



Vidéo



Nos vidéos phlébologie

Vidéo



Vidéos disponibles sur la chaîne YouTube Cizeta Medicali

Vidéo



Vidéo



Vidéo



Rejoignez-nous sur Facebook...

Retrouvez ORTHOSHOP® sur notre page Facebook ainsi que nos publications sur la **prévention** et la prise en charge de la maladie veineuse durant la **grossesse**, le **sport** et le **voyage**.

Cizeta Medicali France



...Instagram

Instagram


@cizetamedicalifrance





...et sur notre page LinkedIn

CIZETA MEDICALI France

LinkedIn

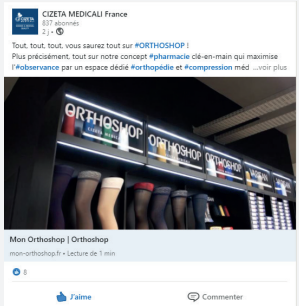

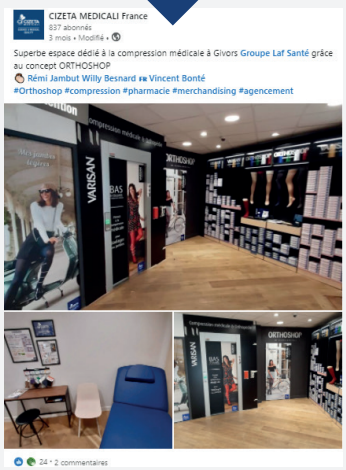

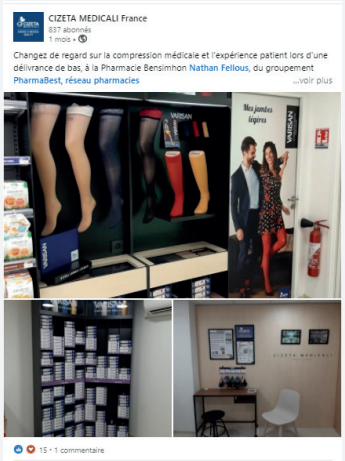

AIDE À LA MOBILITÉ ET AU CONFORT

CANNES ANGLAISES

CANNE CLASSIQUE ADULTE



Vendu par paire

CANNE CONFORT ADULTE



Vendu par paire

CANNE ENFANT



CANNES DERBY

CANNE POIGNET T RÉGLABLE



CANNE PLIANTE BI-MATIÈRE



CANNE PLIANTE FANTAISIE



DÉAMBULATION

DÉAMBULATEUR PLIANT



ROLLATEUR 2 ROUES



ROLLATEUR 4 ROUES



AIDE À LA MOBILITÉ ET AU CONFORT

FAUTEUILS

FAUTEUIL DE TRANSFERT



Disponible en 2 largeurs d'assise :
39 cm et 43 cm

FAUTEUIL ROULANT



Disponible en 3 largeurs d'assise :
41 cm, 46 cm et 51 cm

OREILLER ET MATELAS

OREILLER À MÉMOIRE DE FORME



MATELAS VISCOELASTIQUE



COUSSINS

COUSSIN PRÉVENTION ESCARRE



Disponible en 3 largeurs d'assise :
41 cm, 46 cm et 51 cm

COUSSIN POSITIONNEMENT DÉBUBITUS



Demandez notre catalogue
et nos tarifs remisés



NOTES

NOTES